

Gestionnaire de patients LATITUDE™ - Rapport Quick Notes

Rapport créé : 30 mars 2026

Date de naissance : 11948

Appareil : MOMENTUM X4 CRT-D

G138/382675

Centre : CHU Haut Leveque Bordeaux HOPI

Critères de recherche :

Mode Tachy : Surveill. + Trait.

Dernière transmission du dispositif : 12 mars 2021 02:52 CET

Dernière interrogation au cabinet : 10 mars 2021

Date d'implantation : 24 juin 2019

Groupe de patients : PATIENTS INACTIFS (Principal)

Age, Gender: 77,

Mes alertes

12 mars 2021 02:49		Stimulation bi-ventriculaire < 85%. La stimulation était de 74% entre 11 mars 2021 02:49 et 12 mars 2021 02:49.
11 mars 2021 13:25		Amplitude intrinsèque atriale hors plage.

Pour l'assistance technique, veuillez composer le 1-800-CARDIAC (Amérique) ou contacter votre représentant Boston Scientific local.

Événements depuis la dernière mise à jour (24 juin 2019)

20 janv. 2021 14:01	RTA à 163 min ⁻¹ , Fréq. V moy. en RTA : 70 min ⁻¹
20 janv. 2021 14:00	RTA à 166 min ⁻¹ , Fréq. V moy. en RTA : 70 min ⁻¹
Voir la dernière page pour une liste complète des événements depuis la dernière remise à zéro.	

Batterie

Temps approx. avant explantation : 5.5 ans du 12 mars 2021

Dernier reformatage29 nov. 2020 14:25

Durée de charge9,8 s

Une année restante

Explantation

Sondes	Implantation (24 juin 2019)	Mesure en consultation la plus récente (10 mars 2021)	Mesure quotidienne la plus récente (11 mars 2021)
Atriale			
Amplitude intrinsèque	N.R.	0,2 mV	0,3 mV (10 mars 2021)
Impédance de stimulation	N.R.	514 Ω	503 Ω (10 mars 2021)
Seuil de stimulation	N.R.	1,2 V @ 0,4 ms	N.R.
Ventriculaire droit			
Amplitude intrinsèque	N.R.	18,1 mV	13,5 mV (10 mars 2021)
Impédance de stimulation	N.R.	374 Ω	370 Ω (10 mars 2021)
Seuil de stimulation	N.R.	0,7 V @ 0,4 ms	N.R.
Ventriculaire gauche			
Amplitude intrinsèque	N.R.	4,0 mV	10,2 mV (10 mars 2021)
Impédance de stimulation (aVG)	N.R.	614 Ω	619 Ω (10 mars 2021)
Impédance de stimulation (bVG)		667 Ω	
Seuil de stimulation	N.R.	1,3 V @ 0,8 ms	N.R.
Choc			
Impédance de choc	N.R.	42 Ω	41 Ω (10 mars 2021)

Compteurs Brady/CRT

Depuis dernière RAZ
24 juin 2019

Atriale	92 % stimulé
Ventriculaire droit	92 % stimulé
Ventriculaire gauche (aVG)	91 % stimulé
Ventriculaire gauche (bVG)	0 % stimulé

Compteurs d'arythmie atriale

Depuis dernière RAZ
24 juin 2019

% TA/FA (1 an de données)	<1
---------------------------	----

G138 Version du micrologiciel : H_v1.00.00
©2025 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.

Page 1 de 2

Signature du médecinSign

Tachycardie ventriculaire				
FV	240 min ⁻¹	ATP		41 J, 41 J, 41 Jx6
TV	180 min ⁻¹	Salve	Rampe	41 J, 41 J, 41 Jx4
Tachycardie atriale		Amplitude de stimulation		
Com. mode RTA	170 min ⁻¹	DDIR	 Atriale	2,0 V @ 0,4 ms
Brady/CRT			 Ventriculaire droit	2,0 V @ 0,4 ms
Mode		DDDR	 Ventriculaire gauche (aVG)	4,0 V @ 0,8 ms
Fréquence minimum		60 min ⁻¹	 Ventriculaire gauche (bVG)	Arrêt
Fréquence maximum de suivi		130 min ⁻¹	Sensibilité	
Fréquence maximum capteur		130 min ⁻¹	 Atriale	CAG 0,15 mV
Délai AV stimulé		180 - 280 ms	 Ventriculaire droit	CAG 0,6 mV
Délai AV détecté		115 - 180 ms	 Ventriculaire gauche	CAG 1,0 mV
Période réfractaire A (PRAPV)		240 - 280 ms	Configuration sondes (stim./détec.)	
Période réfractaire VD (PRVD)		230 - 250 ms	 Atriale	Bipolaire
Période réfractaire VG (PRVG)		250 ms	 Ventriculaire droit	Bipolaire
Cavité de stim. ventri.		BiV	 aVG (stimulation)	VGprox3>>boîtier
Correction VG		-50 ms	 bVG (stimulation)	Arrêt
			 VG (détection)	VGdist1>>VGprox2
		Fréquence de stimulation adaptable		
		Ventilation Minute		Marche
		Accéléromètre		Marche
		Stimulation multisite VG		
		Séquence de stimulation		Arrêt

Tous les évènements depuis la dernière remise à zéro (24 juin 2019)

20 janv. 2021 14:01	RTA à 163 min ⁻¹ , Fréq. V moy. en RTA : 70 min ⁻¹
20 janv. 2021 14:00	RTA à 166 min ⁻¹ , Fréq. V moy. en RTA : 70 min ⁻¹
20 janv. 2021 13:58	RTA à 166 min ⁻¹ , Fréq. V moy. en RTA : 70 min ⁻¹
20 janv. 2021 13:58	RTA à 74 min ⁻¹ , Fréq. V moy. en RTA : 79 min ⁻¹
20 janv. 2021 13:57	RTA à 175 min ⁻¹ , Fréq. V moy. en RTA : 75 min ⁻¹
20 janv. 2021 13:57	RTA à 135 min ⁻¹ , Fréq. V moy. en RTA : 70 min ⁻¹
20 janv. 2021 13:54	RTA à 161 min ⁻¹ , Fréq. V moy. en RTA : 70 min ⁻¹
20 janv. 2021 13:54	RTA à 137 min ⁻¹ , Fréq. V moy. en RTA : 70 min ⁻¹
20 janv. 2021 13:52	RTA à 163 min ⁻¹ , Fréq. V moy. en RTA : 70 min ⁻¹
20 janv. 2021 13:49	RTA à 180 min ⁻¹ , Fréq. V moy. en RTA : 69 min ⁻¹
Total événem.: 1480 RTA	





Date de naissance : 1948
 Appareil : **MOMENTUM X4 CRT-D**
G138/382675
 Centre : **CHU Haut Leveque Bordeaux HOPI**
 Critères de recherche :
 Mode Tachy : **Surveill. + Trait.**

Dernière transmission du dispositif : **12 mars 2021 02:52 CET**
 Dernière interrogation au cabinet : **10 mars 2021**
 Date d'implantation : **24 juin 2019**
 Groupe de patients : **PATIENTS INACTIFS (Principal)**
 Age, Gender: **77,**

EGM temps réel (12 mars 2021)

EGM affiché à 25 mm par seconde

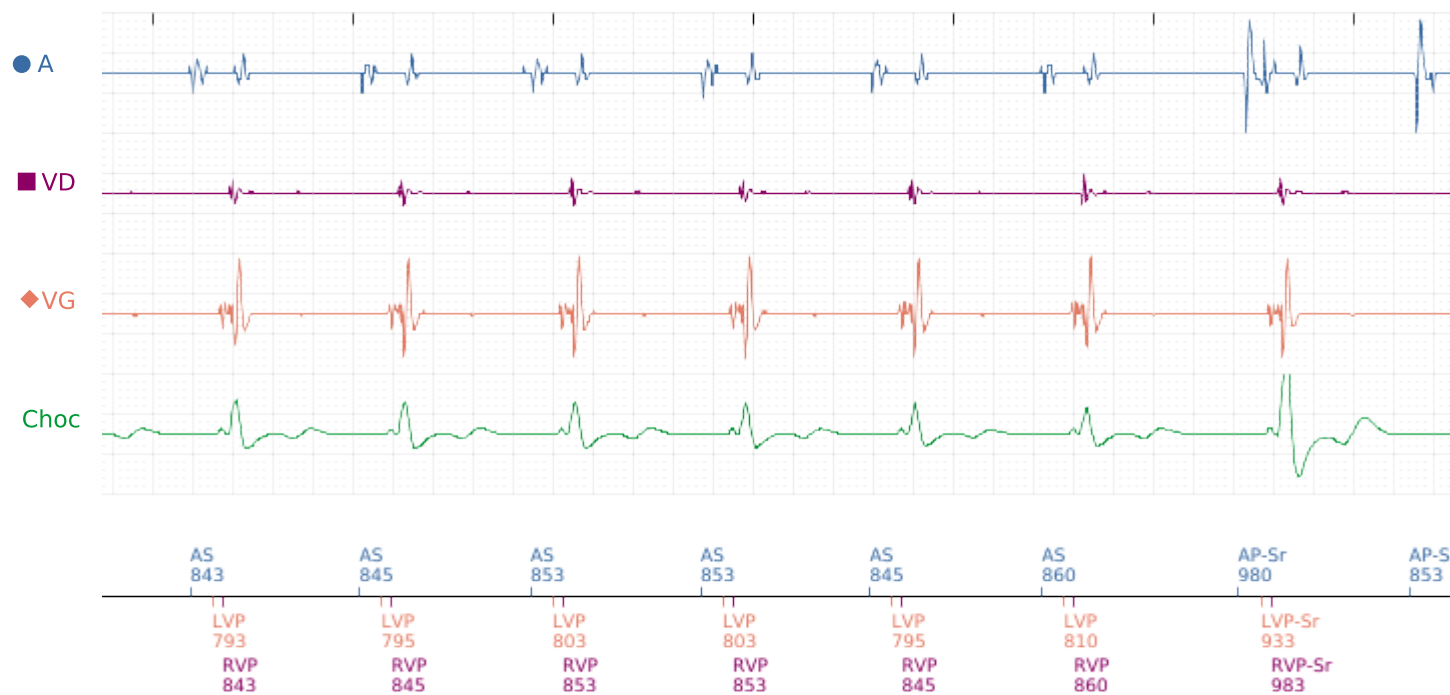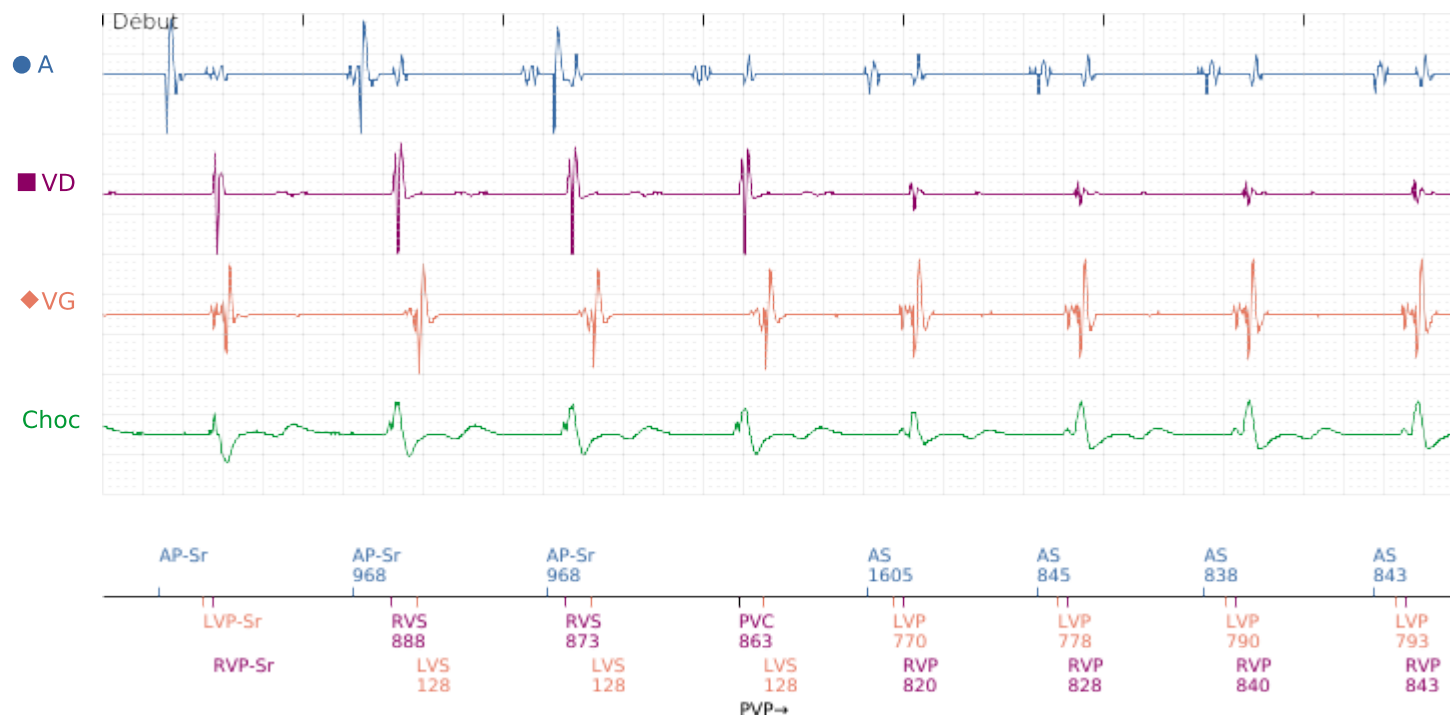



AP-Sr 973
LVP-Sr 918
RVP-Sr 968

AP-Sr 968
LVP-Sr 918
RVP-Sr 968

AP-Sr 968
LVP-Sr 918
RVP-Sr 968

AP-Sr 968
LVP-Sr 918
RVP-Sr 968

AP-Sr 968
LVP-Sr 918
RVP-Sr 968

AP-Sr 968
RVS 865
LVS 130

AP-Sr 968



AP-Sr 968
RVS 925
LVS 130

AP-Sr 968
[RVS]RVP-Sr 1173
LVP-Sr 1123

AP-Sr 968
[RVS]RVP-Sr 968
LVP-Sr 918

AP-Sr 968
[RV]inh-LVP
LVRVP-Sr 86968

AP-Sr 968
[RV]inh-LVP
LVRVP-Sr 84968

PVC 683
LVS 125
PVP→

AP-Sr 1650
LVP-Sr 918
RVP 968





Date de naissance :
 Appareil : **MOMENTUM X4 CRT-D**
G138/382675
 Centre : **CHU Haut Leveque Bordeaux HOPI**
 Critères de recherche :
 Mode Tachy : **Surveill. + Trait.**


Dernière transmission du dispositif : **12 mars 2021 02:52 CET**
 Dernière interrogation au cabinet : **10 mars 2021**
 Date d'implantation : **24 juin 2019**
 Groupe de patients : **PATIENTS INACTIFS (Principal)**
 Age, Gender : **77,**

Mes alertes

- 12 mars 2021 02:49  Stimulation bi-ventriculaire < 85%. La stimulation était de 74% entre 11 mars 2021 02:49 et 12 mars 2021 02:49.
- 11 mars 2021 13:25  Amplitude intrinsèque atriale hors plage.

Pour l'assistance technique, veuillez composer le 1-800-CARDIAC (Amérique) ou contacter votre représentant Boston Scientific local.

Graphiques

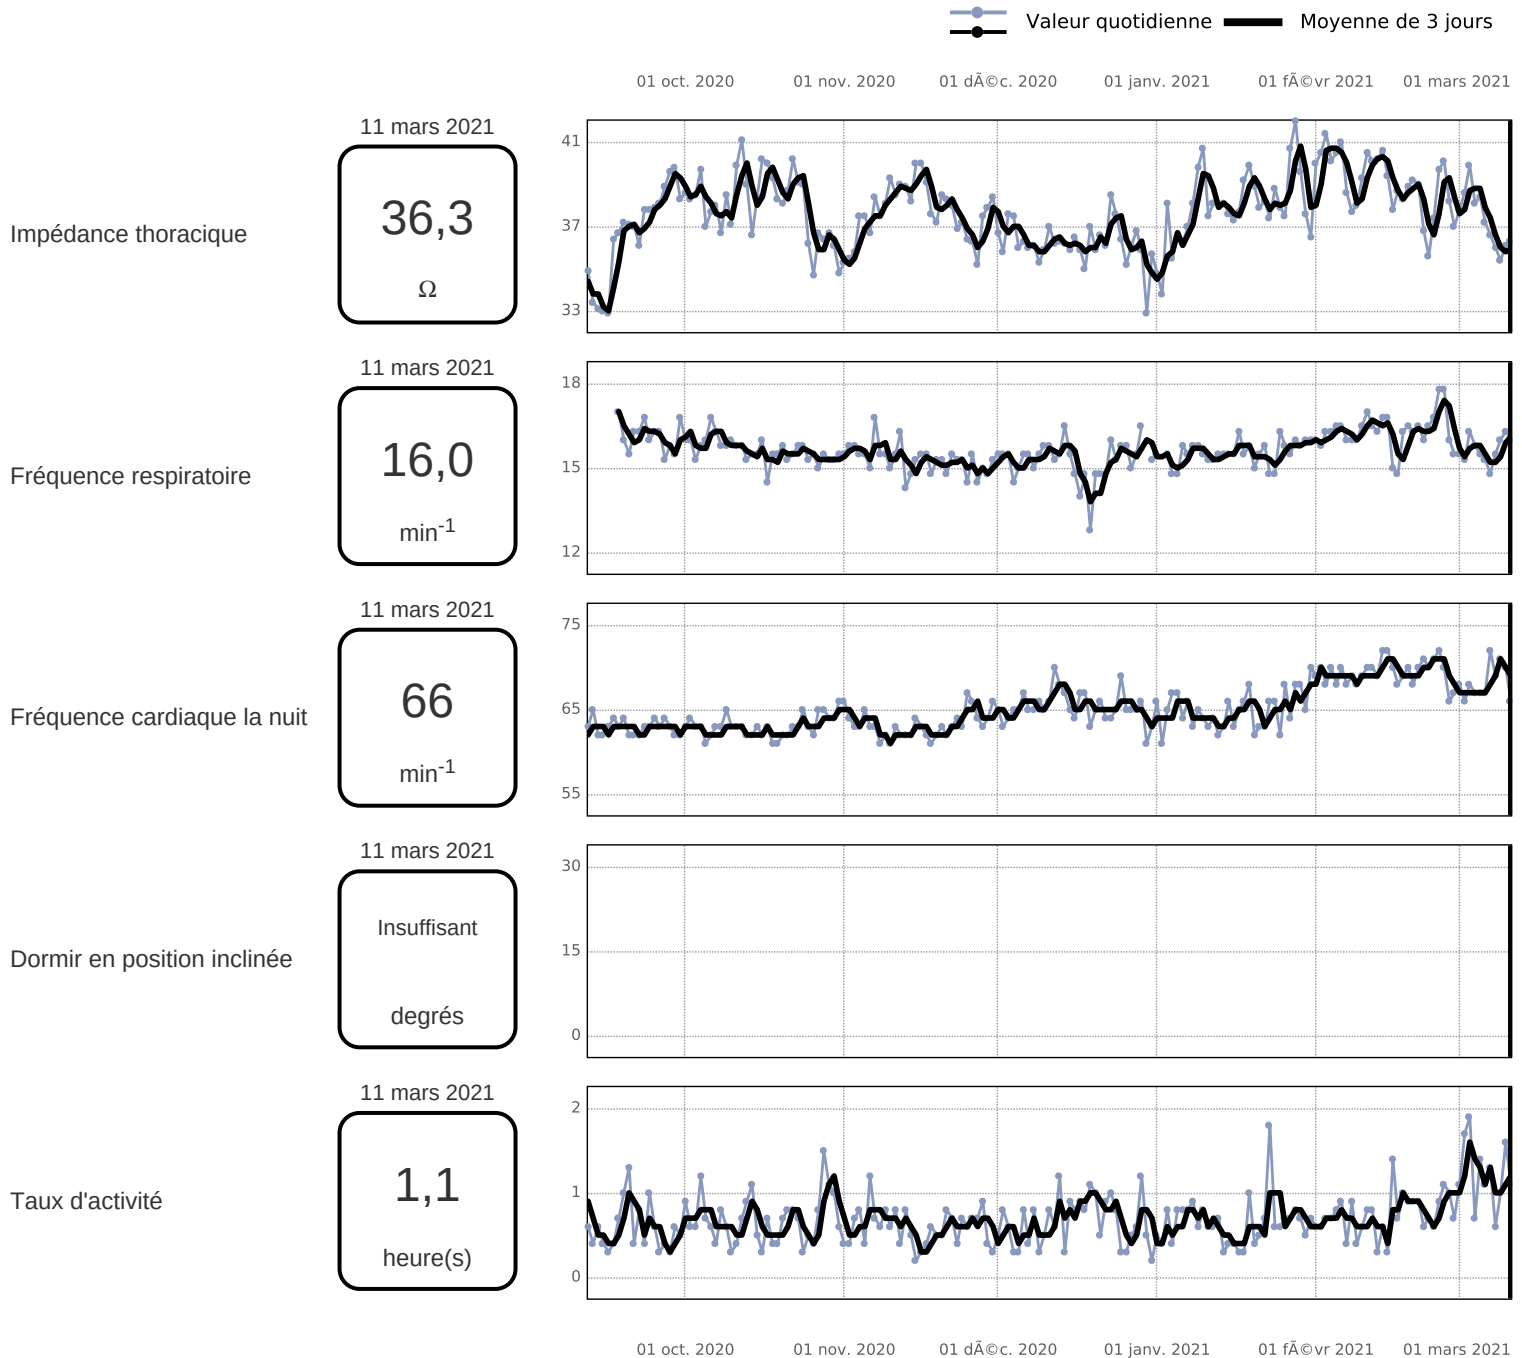

—●— Valeur quotidienne — Moyenne de 3 jours


01 oct. 2020 01 nov. 2020 01 dÃ©c. 2020 01 janv. 2021 01 fÃ©vr 2021 01 mars 2021

AP Scan™

11 mars 2021

Insuffisant

événem./h

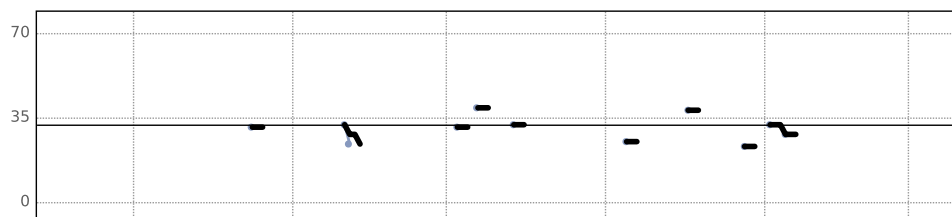


Charge TA/FA

11 mars 2021

0,0

heure(s)

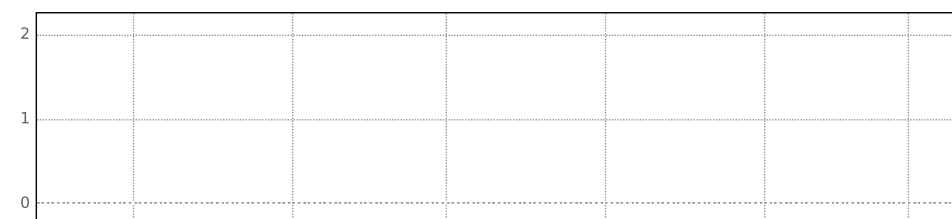

Traitement V

11 mars 2021

Fréquence VD durant la TA/FA


Max
Moyenne

N.R.
N.R.min⁻¹

Fréquence cardiaque moyenne

11 mars 2021

70

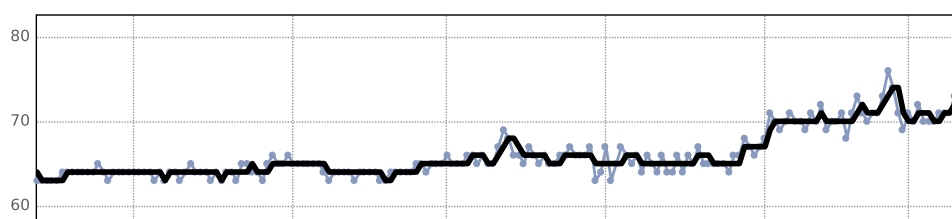
min⁻¹

% Stimulation VG

11 mars 2021

92

%

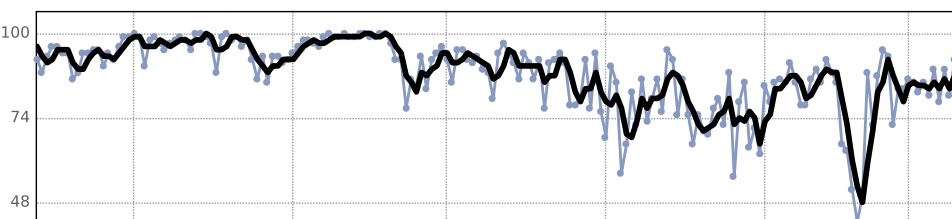


Variabilité de fréquence cardiaque (SDANN)

11 mars 2021

Insuffisant

ms

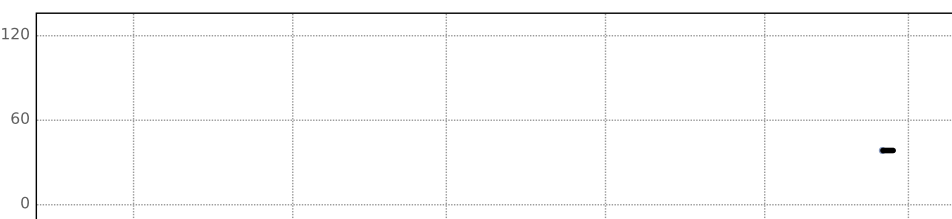

01 oct. 2020 01 nov. 2020 01 dÃ©c. 2020 01 janv. 2021 01 fÃ©vr 2021 01 mars 2021

Batterie **OK**Temps approx. avant explantation : **5.5 ans** du 12 mars 2021

Données numériques									
Date	Impédance thoracique (Ω)	Fréquence respiratoire (min ⁻¹)	Fréquence cardiaque la nuit (min ⁻¹)	Dormir en position inclinée (degrés)	Taux d'activité (heure(s))	AP Scan™ (événem./h)	Charge TA/FA (heure(s); événements)	Fréquence VD durant la TA/FA (max; moyenne) (min ⁻¹)	Fréquence cardiaque moyenne (min ⁻¹)
11 mars 2021	36,3	16,0	66	N.R.	1,1	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	70
10 mars 2021	36,1	16,3	70	N.R.	1,6	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	73
09 mars 2021	35,4	16,0	71	N.R.	1,0	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	71
08 mars 2021	36,0	15,5	69	N.R.	0,6	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	71
07 mars 2021	36,6	14,8	72	N.R.	1,3	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	71
06 mars 2021	37,2	15,3	67	N.R.	1,1	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	70
05 mars 2021	38,4	15,5	67	N.R.	1,4	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	70
04 mars 2021	38,1	15,8	67	N.R.	0,7	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	70
03 mars 2021	39,9	16,3	68	N.R.	1,9	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	72
02 mars 2021	38,6	15,3	66	N.R.	1,7	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	70
01 mars 2021	37,8	15,5	68	N.R.	1,1	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	71
28 févr. 2021	37,0	15,5	67	N.R.	0,7	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	69
27 févr. 2021	38,2	16,0	66	N.R.	1,0	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	71
26 févr. 2021	40,1	17,8	70	N.R.	1,1	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	74
25 févr. 2021	39,7	17,8	72	N.R.	0,9	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	76
24 févr. 2021	37,4	16,8	71	N.R.	0,6	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	73
23 févr. 2021	35,6	16,5	70	N.R.	0,7	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	71
22 févr. 2021	36,8	16,0	71	N.R.	0,6	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	71
21 févr. 2021	39,0	16,5	70	N.R.	0,9	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	70
20 févr. 2021	39,2	16,3	68	N.R.	0,9	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	71
19 févr. 2021	38,9	16,5	70	N.R.	0,9	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	73
18 févr. 2021	38,3	16,3	69	N.R.	1,0	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	71
17 févr. 2021	38,7	14,8	68	N.R.	0,7	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	68
16 févr. 2021	37,8	15,0	70	N.R.	1,4	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	71
15 févr. 2021	39,4	16,8	72	N.R.	0,3	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	70
14 févr. 2021	40,6	16,8	72	N.R.	0,6	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	70
13 févr. 2021	40,2	16,3	69	N.R.	0,3	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	69
12 févr. 2021	40,1	16,5	70	N.R.	0,8	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	72
11 févr. 2021	40,5	17,0	70	N.R.	0,8	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	70
10 févr. 2021	39,3	16,5	69	N.R.	0,6	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	71

Date	% Stimulation VG (%)	Variabilité de fréquence cardiaque (SDANN) (ms)
11 mars 2021	92	N.R.
10 mars 2021	92	N.R.
09 mars 2021	81	N.R.
08 mars 2021	89	N.R.
07 mars 2021	79	N.R.
06 mars 2021	89	N.R.
05 mars 2021	81	N.R.
04 mars 2021	85	N.R.
03 mars 2021	82	N.R.
02 mars 2021	85	N.R.
01 mars 2021	86	N.R.
28 févr. 2021	83	N.R.
27 févr. 2021	83	N.R.
26 févr. 2021	72	N.R.
25 févr. 2021	93	N.R.
24 févr. 2021	95	38
23 févr. 2021	87	N.R.
22 févr. 2021	72	N.R.
21 févr. 2021	88	N.R.
20 févr. 2021	50	N.R.
19 févr. 2021	42	N.R.
18 févr. 2021	52	N.R.
17 févr. 2021	64	N.R.
16 févr. 2021	66	N.R.
15 févr. 2021	85	N.R.
14 févr. 2021	88	N.R.
13 févr. 2021	92	N.R.
12 févr. 2021	85	N.R.
11 févr. 2021	89	N.R.
10 févr. 2021	86	N.R.