



203

Date de naissance :
Appareil : **AUTOGEN CRT-D**
Centre :
Critères de recherche :
Mode Tachy : **Surveill. + Trait.**


Dernière transmission du dispositif : **09 nov. 2014 02:12 CET**
Dernière interrogation au cabinet : **03 nov. 2014**
Date d'implantation : **3 oct. 2014**
Groupe de patients :

EGM temps réel (09 nov. 2014)

EGM affiché à 25 mm par seconde





RVS	LVP	RVS	LVP	RVS	LVP	RVS	LVP	R
0	0	645	0	638	0	625	0	6
LVS	RVP	LVS	RVP	LVS	RVP	LVS	RVP	L
5	1000	5	1000	5	1000	5	1000	8

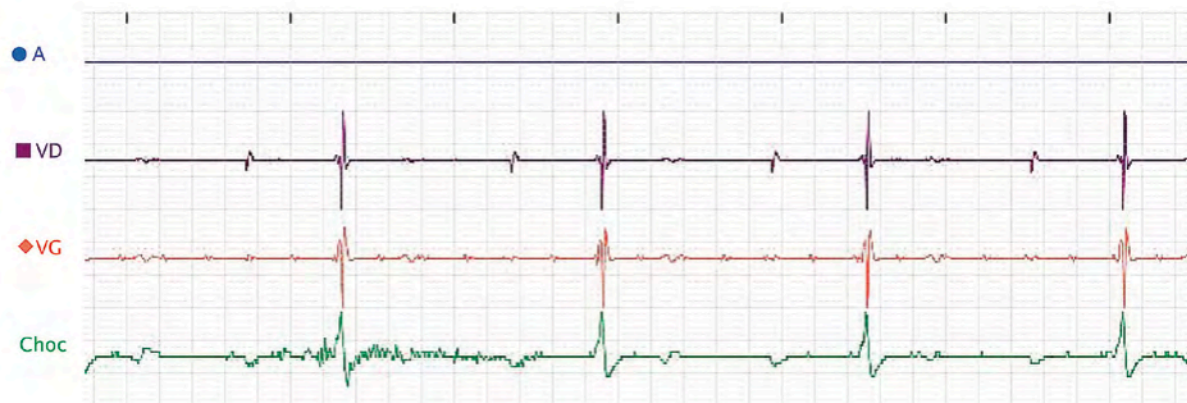

VS	LVP	RVS	LVP	RVS	LVP	RVS	LVP-Sr	RVS
30	0	618	0	593	0	615	0	598
VS	RVP	LVS	RVP	LVS	RVP	LVS	RVP-Sr	LVS
VS	1000	5	1000	5	1000	5	968	5

203

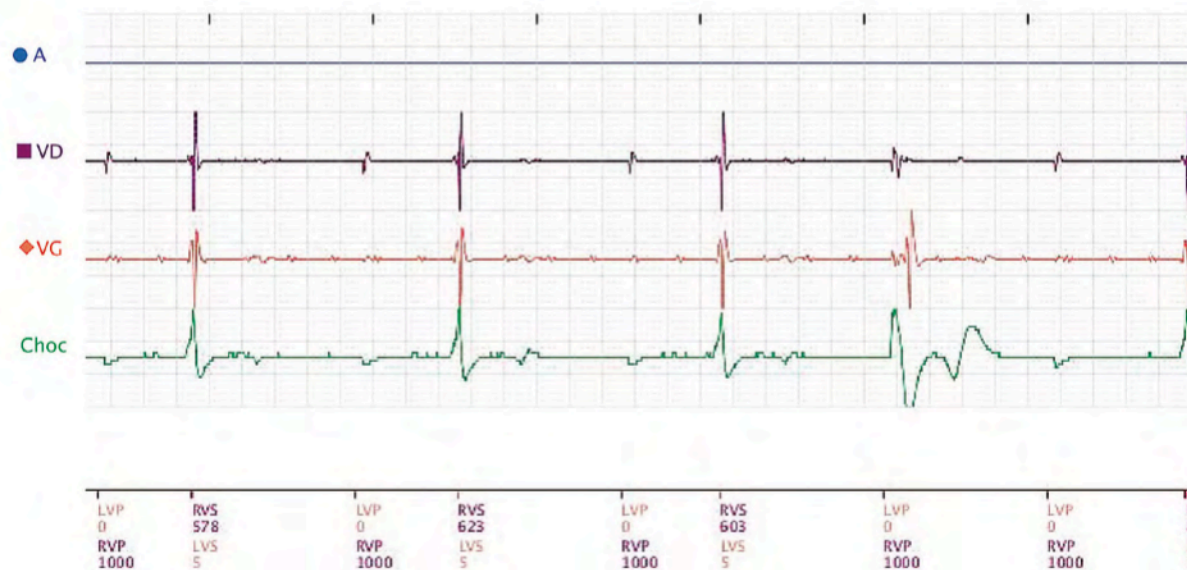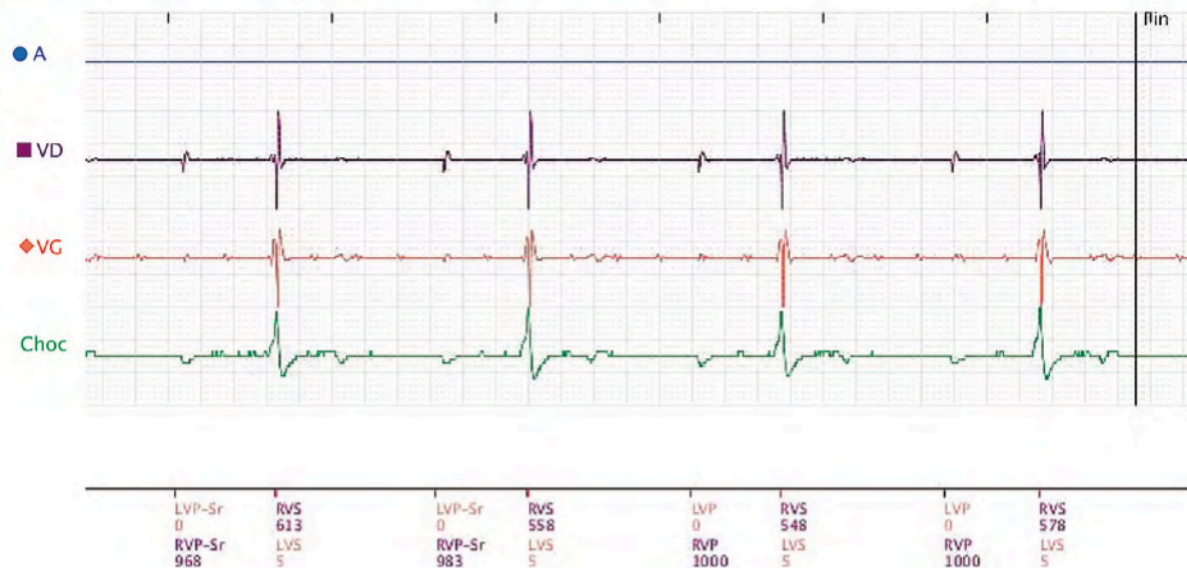

Rapport des épisodes sélectionnés

Date naiss. Appareil
Mode Tachy

AUTOGEN CRT-D
Surveill. + Trait.

Dernière interrogation bureau

4 Dec 2014

Date implant.

3 Oct 2014

Événement APM-14: 29 Nov 2014 01:01


APM RT Début événem.

Fréq. A moy. : 30 min⁻¹

Fréq. V moy. : 74 min⁻¹

Fin de l'événement -----



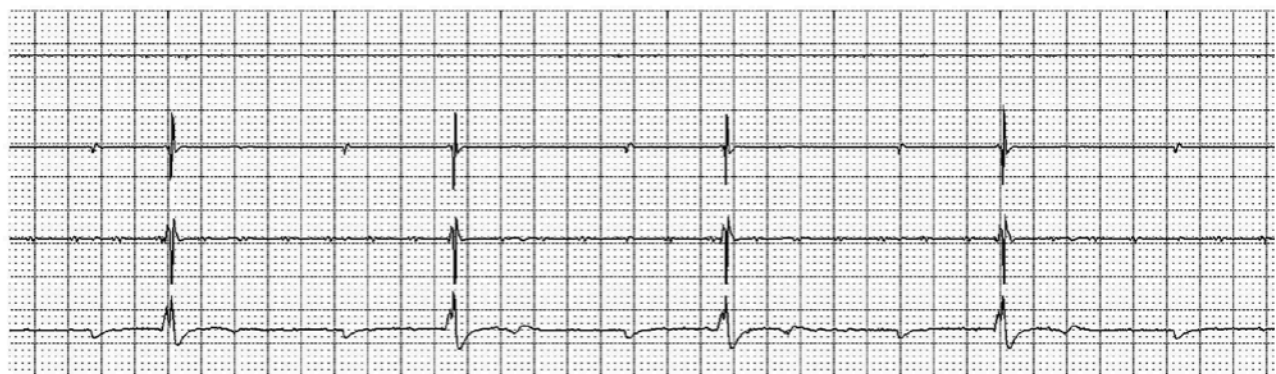

RVP
1000
LVP
0

RVS
508
LVS
3

RVP
1000
LVP
0

RVS
698
LVS
5


RVP
1000
LVP
0

RVS
633
LVS
8

RVP
1000
LVP
0

RVS
663
LVS
8

RVP
1000
LVP
0

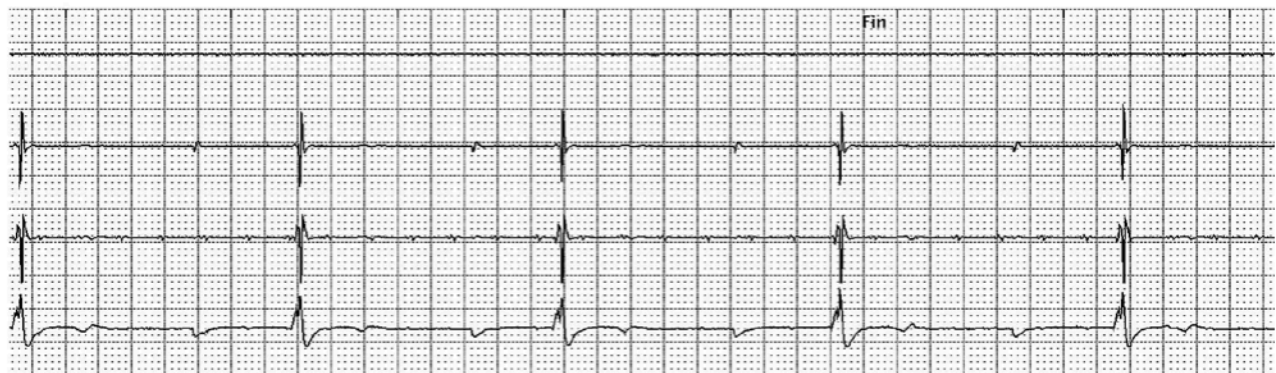

Fin

RVS
715
LVS
5

RVP
1000
LVP
0

RVS
675
LVS
5

RVP
1000
LVP
0

RVS
573
LVS
3

RVP
1000
LVP
0

RVS
673
LVS
5

RVP
1000
LVP
0

RVS
690
LVS
8

Date naiss.

Appareil

Mode Tachy

AUTOGEN CRT-D

Surveill. + Trait.

Dernière interrogation bureau

8 Dec 2014

Date implant.

3 Oct 2014

Cliché du seuil de stimulation-2

08 Dec 2014 12:07:25



Date naiss.

Appareil

Mode Tachy

AUTOGEN CRT-D

Surveill. + Trait.

Dernière interrogation bureau

8 Dec 2014

Date implant.



3 Oct 2014

Cliché du seuil de stimulation-4

Config. sonde stim.

08 Dec 2014 12:09:49

VGdist»VGprox

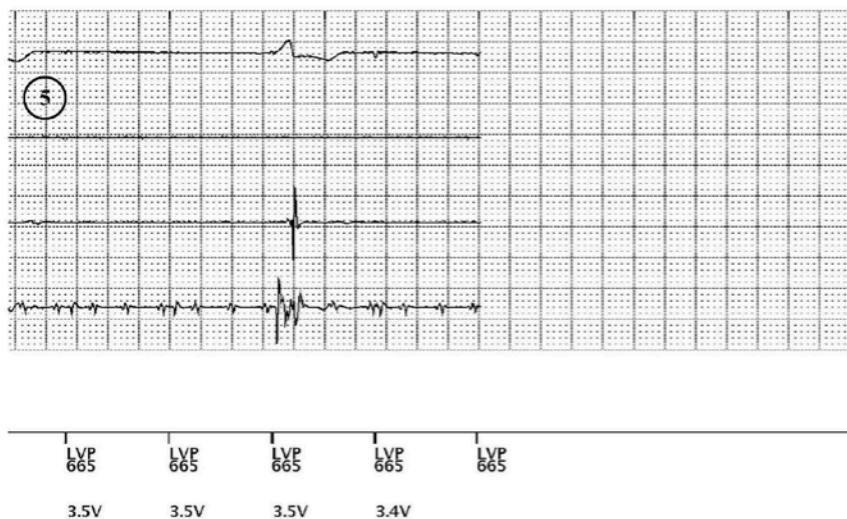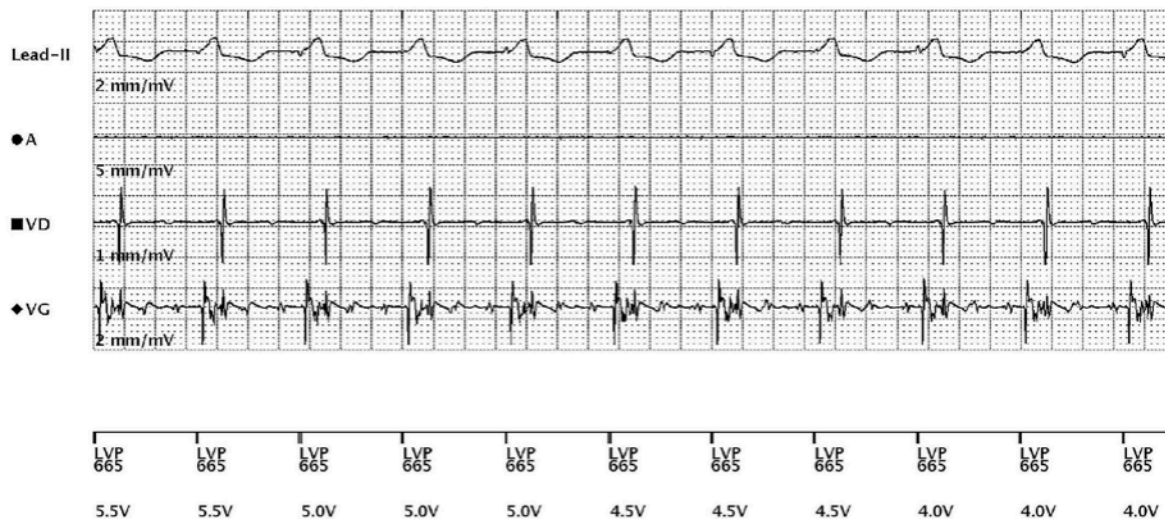

Cliché du seuil de stimulation-3

Config. sonde stim.

08 Dec 2014 12:08:58

VGdist»boîtier

