


Mes alertes

Pour l'assistance technique, veuillez composer le 1-800-CARDIAC (Amérique) ou contacter votre représentant Boston Scientific local.


08 sept. 2026 22:51 VG auto
08 sept. 2026 17:43 RTA à 225 min⁻¹, Fréq. V moy. en RTA : 0 min⁻¹
Voir la dernière page pour une liste complète des événements depuis la dernière remise à zéro.





Paramètres					
Tachycardie ventriculaire					
FV	240 min ⁻¹	ATP			41 J, 41 J, 41 Jx6
TV	185 min ⁻¹	Salve	Rampe		41 J, 41 J, 41 Jx4
TV-1	165 min ⁻¹	Surveillance seule			
Tachycardie atriale		Amplitude de stimulation			
Com. mode RTA	170 min ⁻¹	VDI	 Atriale		Tendance 2,0 V @ 0,4 ms
Brady/CRT					
Mode		DDD	 Ventriculaire droit		Tendance 2,2 V @ 0,4 ms
Fréquence minimum		50 min ⁻¹	 Ventriculaire gauche (aVG)		Tendance 4,0 V @ 0,6 ms
Fréquence maximum de suivi		155 min ⁻¹	 Ventriculaire gauche (bVG)		Arrêt
Délai AV stimulé		100 - 160 ms	Sensibilité		
Délai AV détecté		75 - 120 ms	 Atriale		CAG 0,25 mV
Période réfractaire A (PRAPV)		280 - 280 ms	 Ventriculaire droit		CAG 0,6 mV
Période réfractaire VD (PRVD)		230 - 250 ms	 Ventriculaire gauche		CAG 1,0 mV
Période réfractaire VG (PRVG)		250 ms	Configuration sondes (stim./détec.)		
Cavité de stim. ventri.		BiV	 Atriale		Bipolaire
Correction VG		0 ms	 Ventriculaire droit		Bipolaire
			 aVG (stimulation)		VGprox2>>boîtier
			 bVG (stimulation)		Arrêt
			 VG (détection)		VGdist1>>VGprox2
		Fréquence de stimulation adaptable			
		Ventilation Minute			Passif
		Accéléromètre			Passif
		Stimulation multisite VG			
		Séquence de stimulation			Arrêt
Mise à jour de l'ID de Rythme					
Dernier essai réussi le					05 sept. 2026 00:47

Graphiques

R = Remise à zéro des compteurs
P = Programmer
I = interrogation en consultation

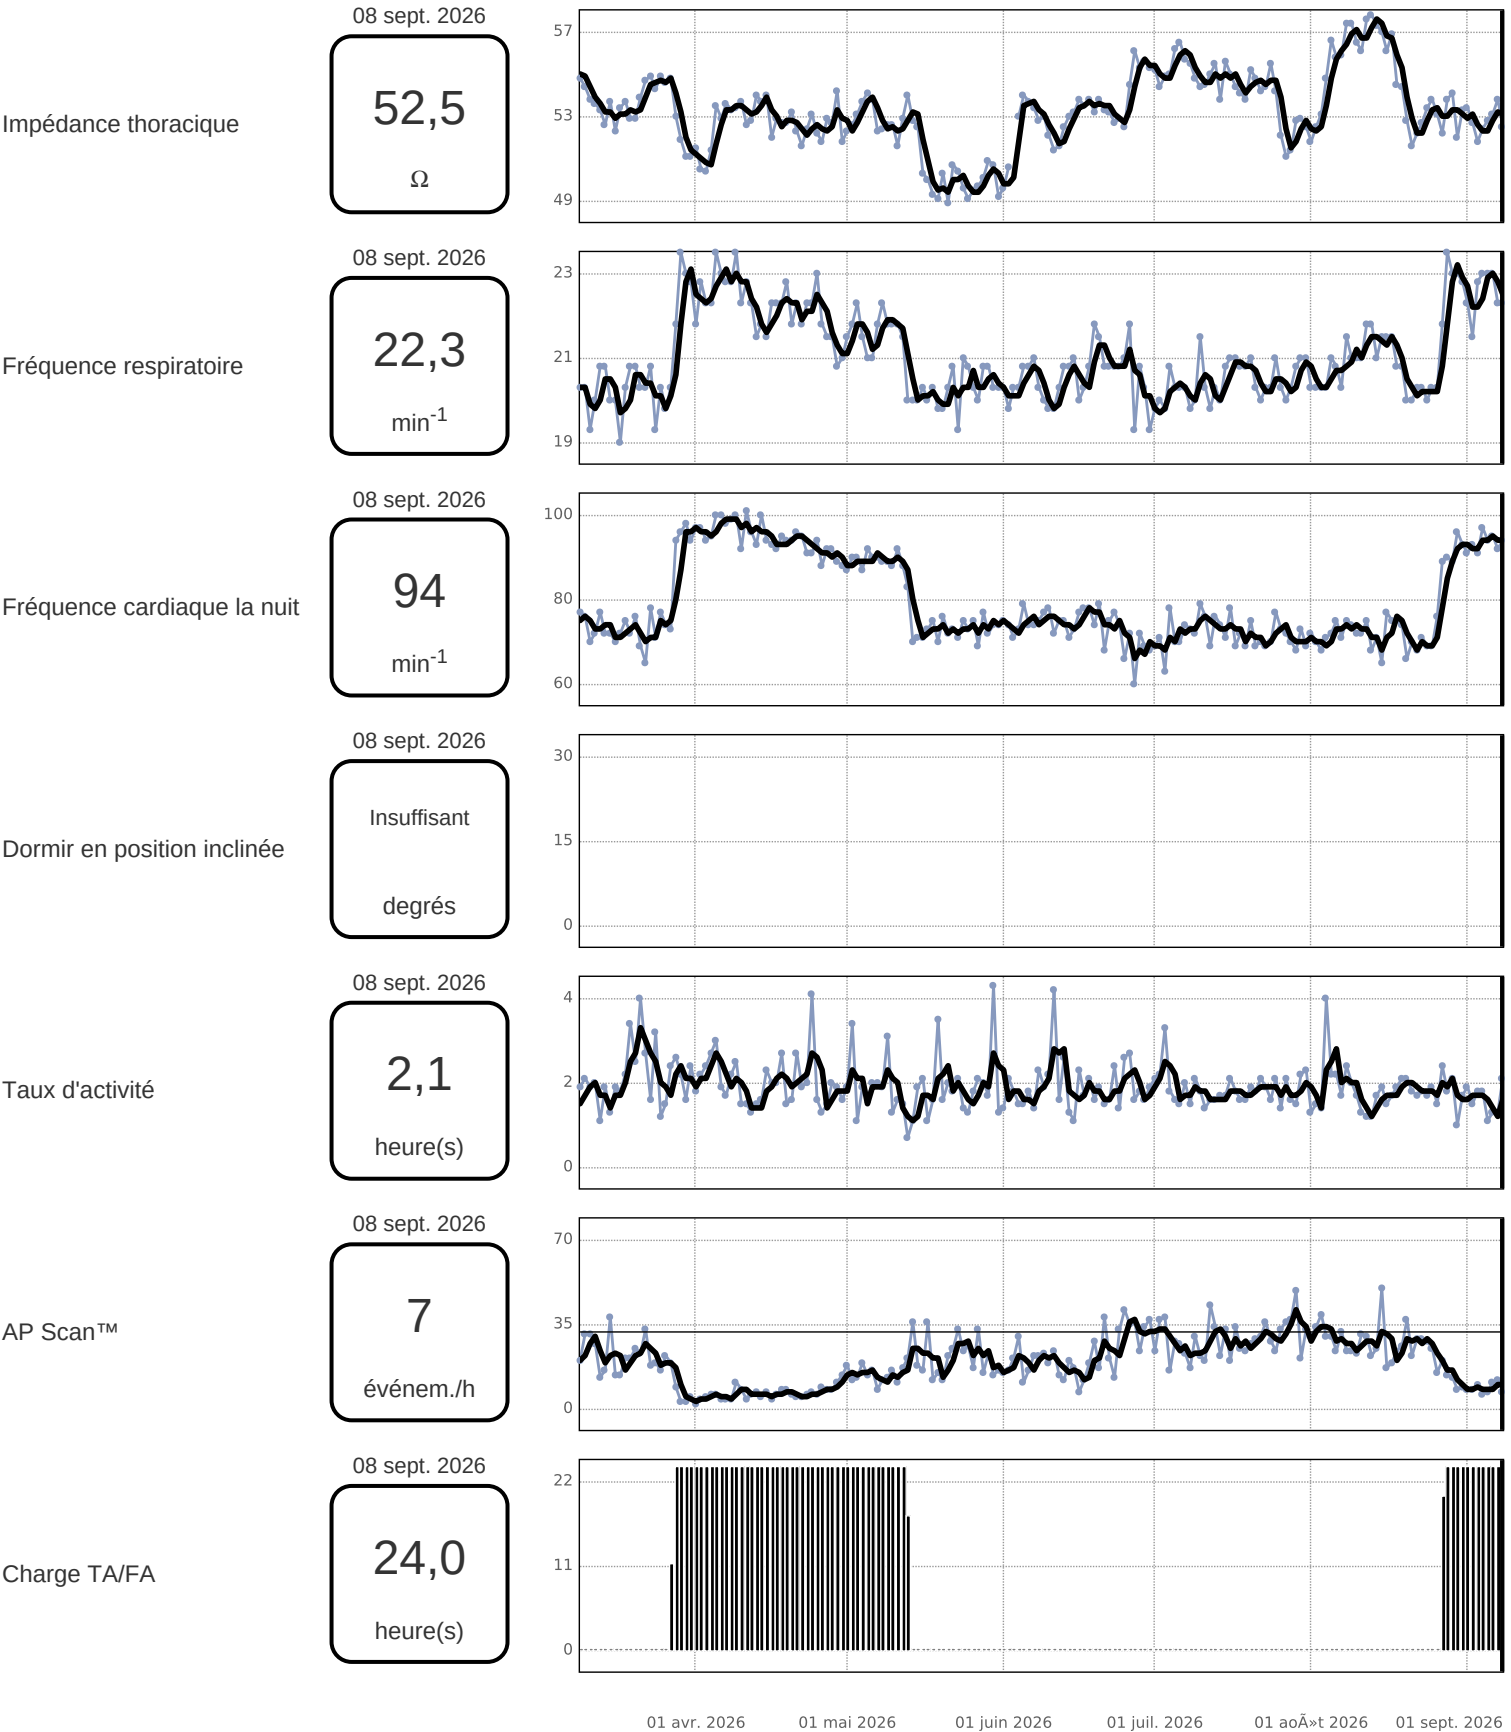

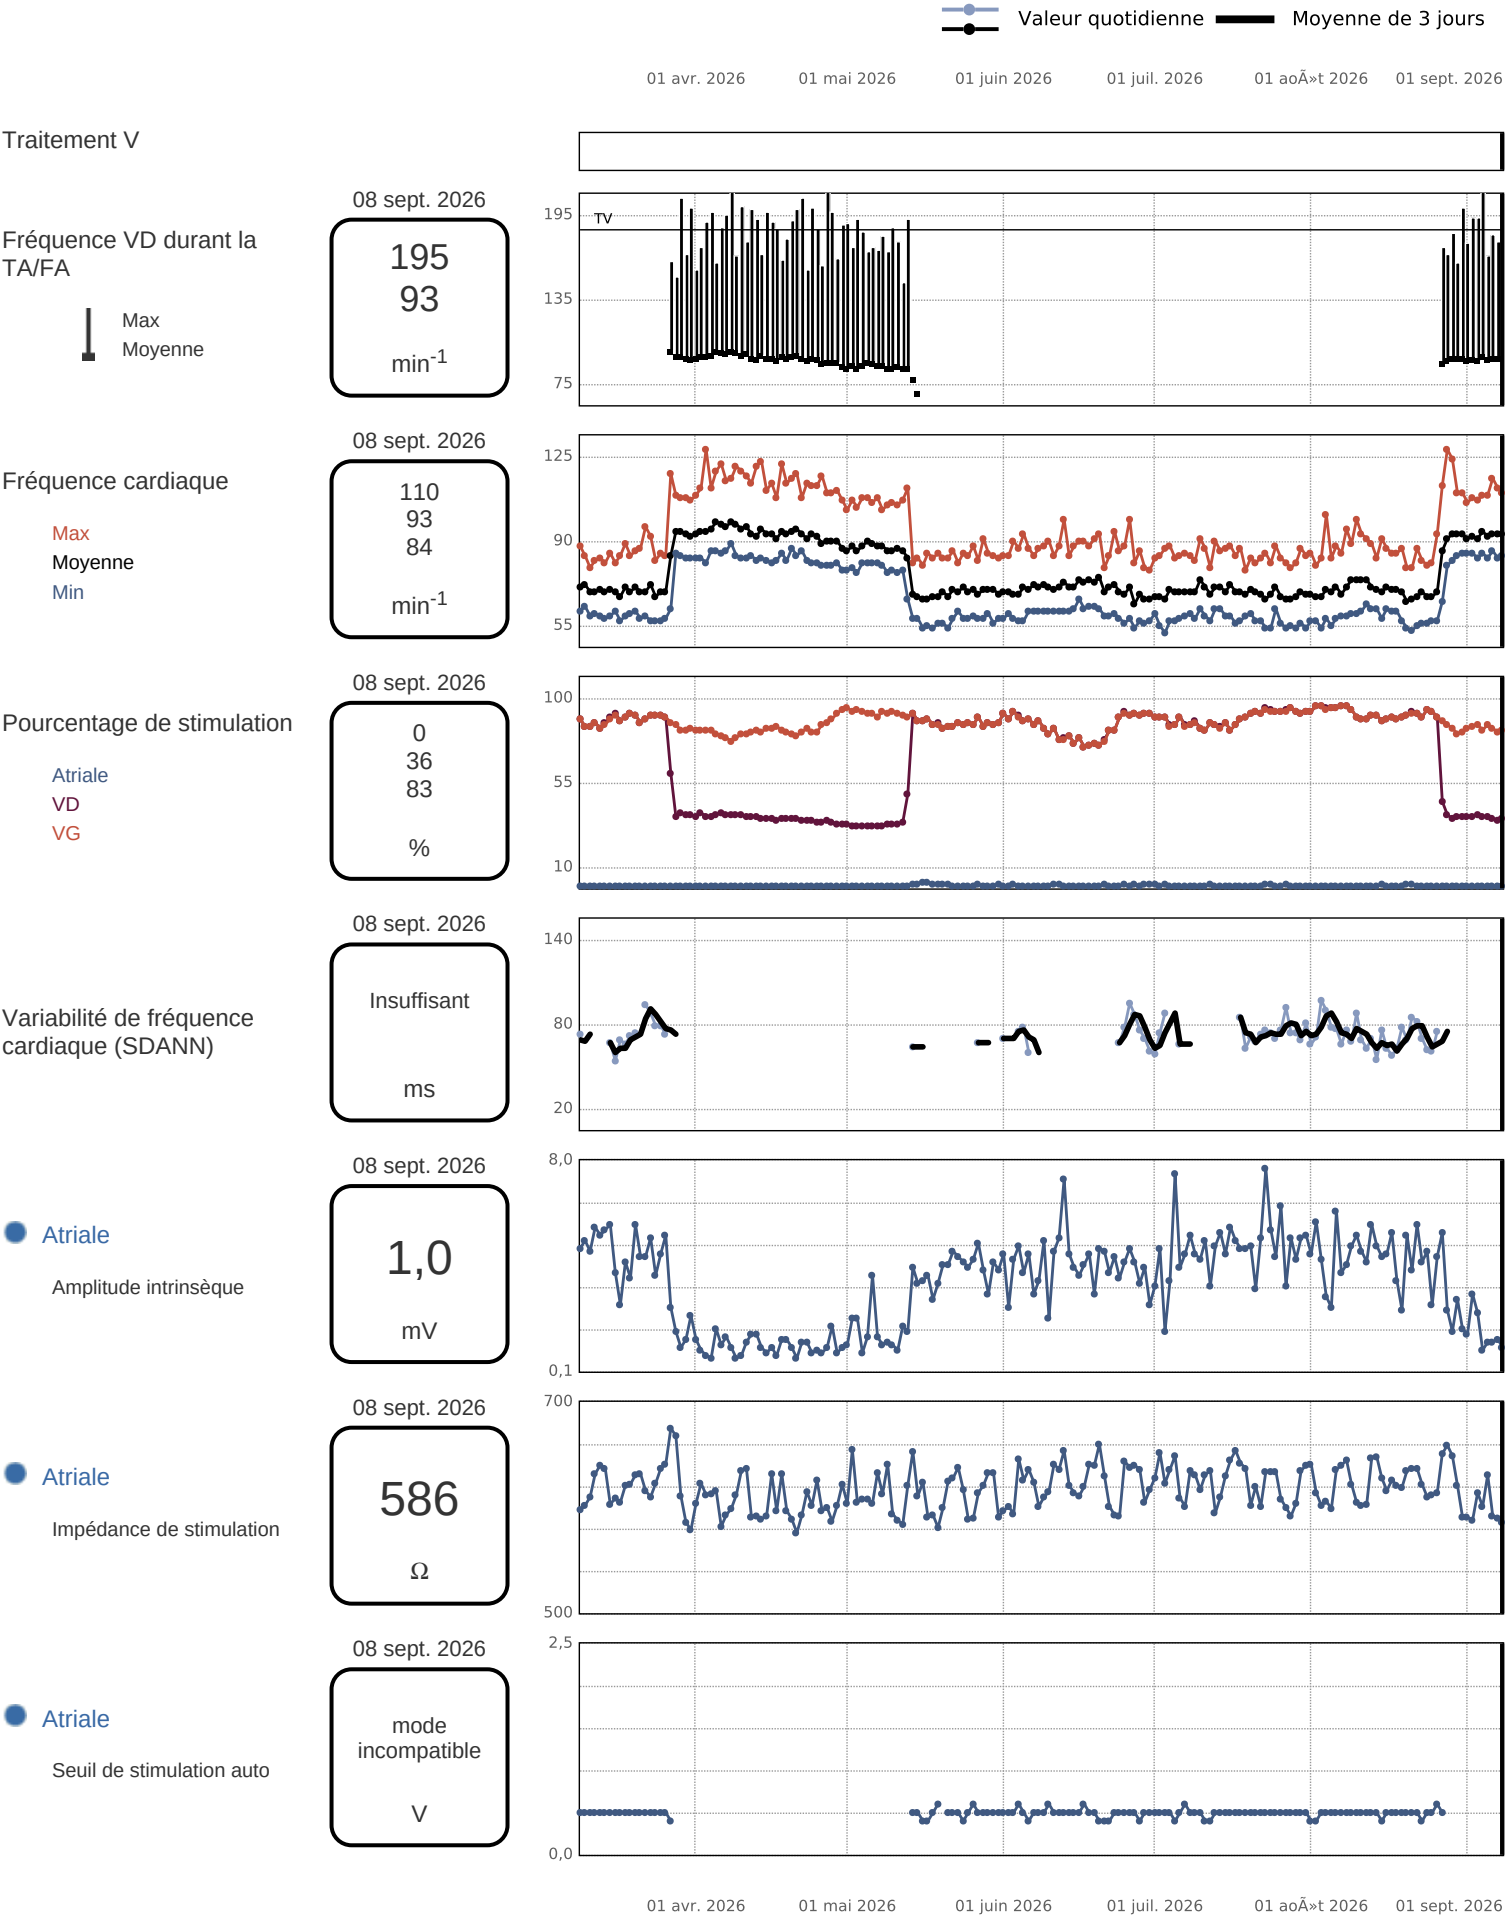

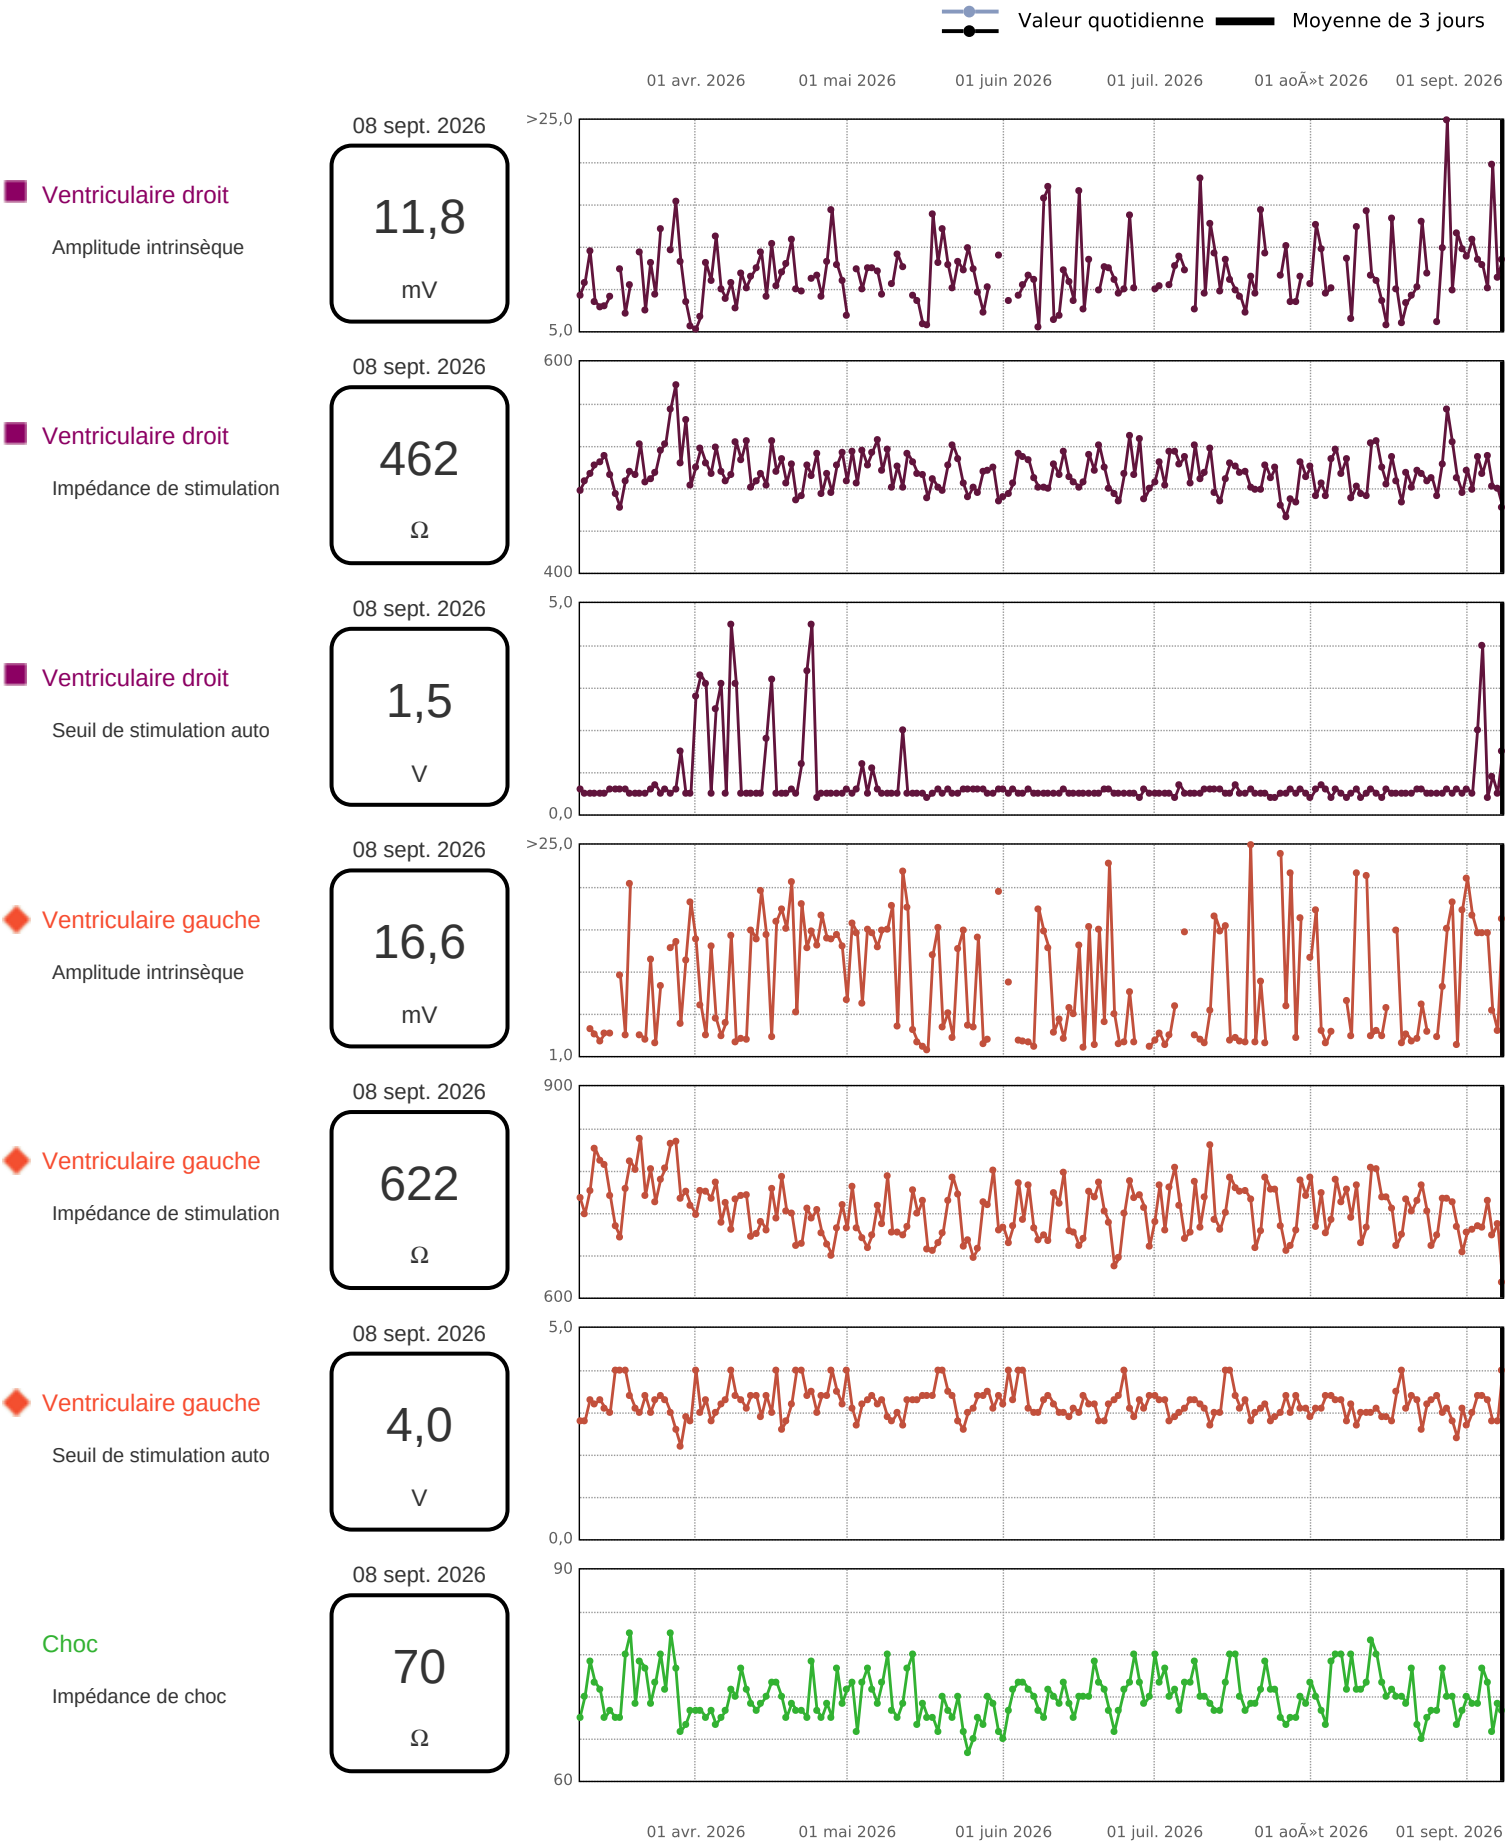

Compteurs tachy ventriculaire	Depuis dernière RAZ 25 juil. 2019	Totaux appareil
Compteurs des épisodes V		
Total épisodes	305	305
Traités		
Traitement FV	0	0
 Traitement TV	2	2
Traitement TV-1	0	0
Traitement commandé	0	0
Non traités		
Aucun traitement programmé	0	0
 Épisodes V non soutenus	302	302
Autres épisodes non traités	1	1
Compteurs traitement V		
ATP délivré	2	2
% ATP réussi	50	50
Chocs délivrés	0	0
% Premier choc efficace	0	0
Chocs déviés	0	0


Compteurs Brady/CRT	Avant-dernière RAZ 180 jour(s) 26 janv. 2019 à 25 juil. 2019	Depuis dernière RAZ 2602 jour(s) 25 juil. 2019 à 09 sept. 2026
Compteurs		
% Stimulation A	12	1
% Stimulation VD	100	93
% aVG stimulé	100	96
% bVG stimulé	0	0
Préférence intrinsèque		
Hystérésis de fréquence		
% Réussi	0	0
Arythmie atriale		
% TA/FA (1 an de données)	N.R.	16
Temps total en TA/FA (jours) (1 an de données)	N.R.	60,0
Épisodes par durée		
< 1 minute	1	24
1 min - < 1 h	0	9
1 h - < 24 h	0	12
24 h - < 48 h	0	9
> 48 h	0	15
Total d'ESA	1747	119283
Compteurs ventriculaires		
Total d'ESV	59064	6628022
Trois ESV ou plus	3	65

Compteurs cliniques	Depuis dernière RAZ 25 juil. 2019	Totaux appareil
Mode Protection IRM	0	0


Aperçu TA/FA : Depuis dernière RAZ (25 juil. 2019 à 09 sept. 2026)		
TA/FA (1 an de données) : 16 %	Événements TA/FA : 69	
Temps total en TA/FA (jours) (1 an de données) : 60,0		
Plus récent : 03 sept. 2026 01:05	Fréq. V moy. : 93 min ⁻¹	Durée : >48 Heures
Plus long : 29 oct. 2020 15:46	Fréq. V moy. : 102 min ⁻¹	Durée : >48 Heures
Fréquence RVS la plus rapide : 28 oct. 2020 09:09	Fréquence V maximum : 243 min ⁻¹	Durée : 30:37:05 hh:mm:ss

Aperçu TA/FA : Avant-dernière RAZ (26 janv. 2019 à 25 juil. 2019)		
Plus long : 19 juil. 2019 03:02	Fréq. V moy. : 75 min ⁻¹	Durée : 00:00:03 hh:mm:ss
Fréquence RVS la plus rapide : 19 juil. 2019 03:02	Fréquence V maximum : N.R.	Durée : 00:00:03 hh:mm:ss


Histogrammes




Activité atriale

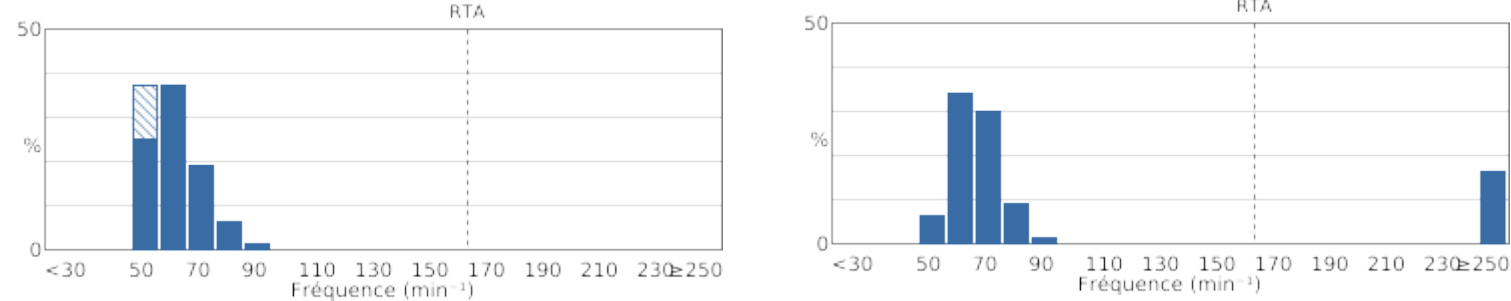


Activité ventriculaire

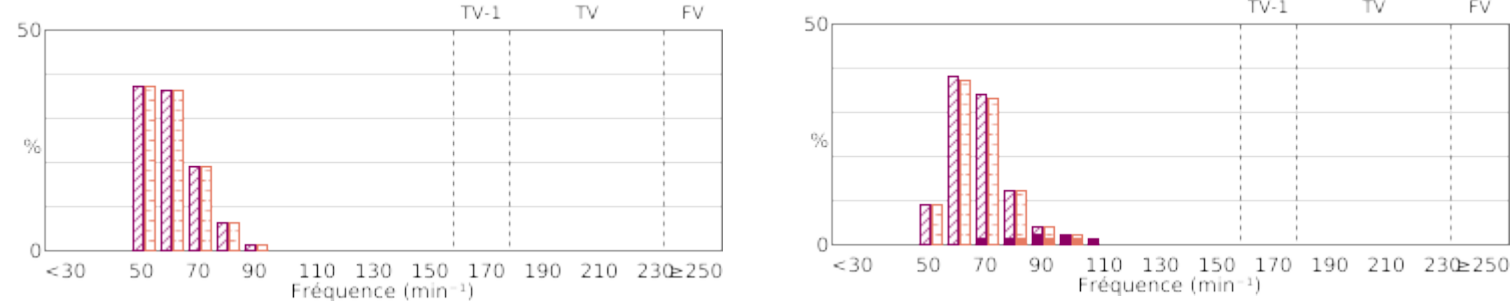


Réponse ventriculaire à une stimulation atriale

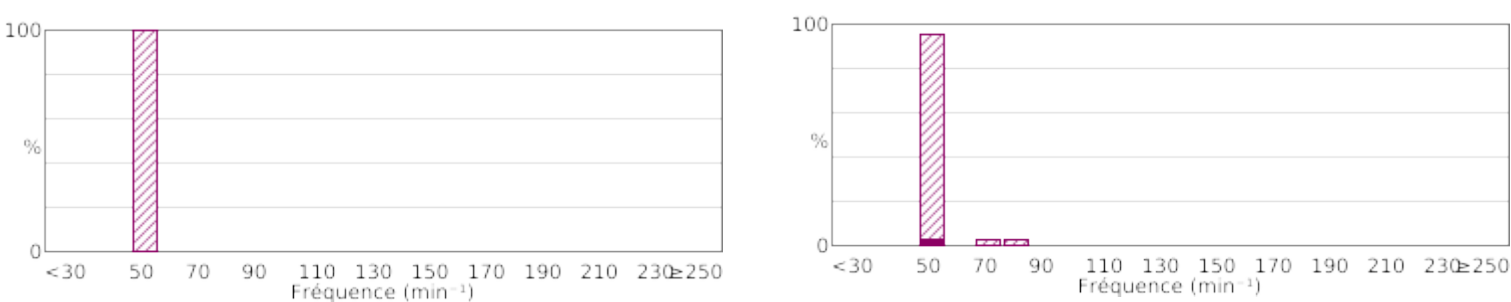

Réponse ventriculaire à une détection atriale

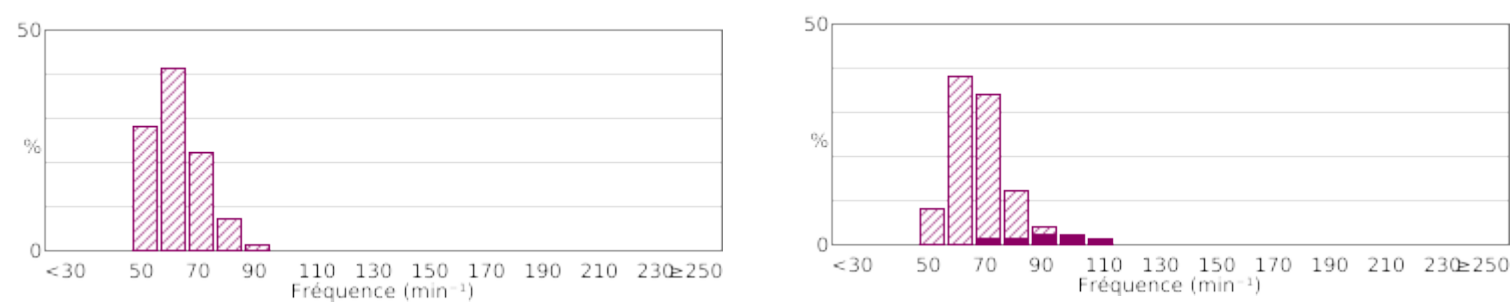

Fréquence VD durant la TA/FA

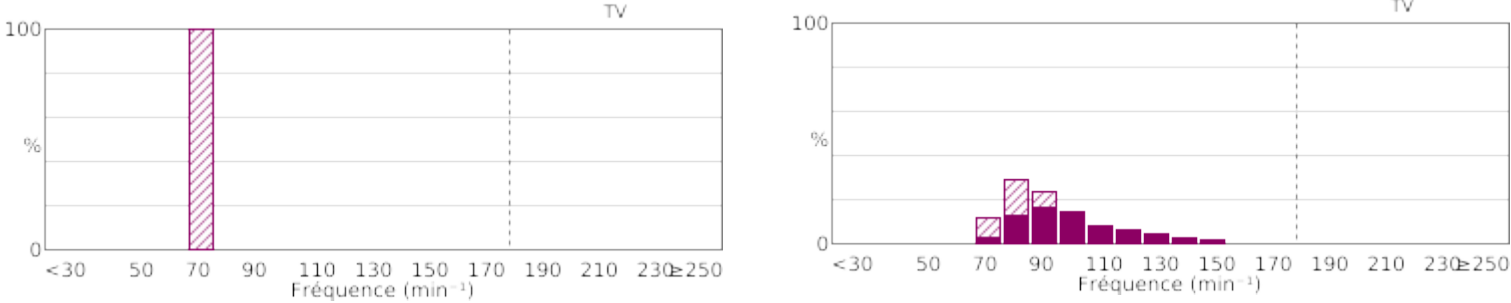

Compteurs de fréquence des histogrammes

Avant-dernière RAZ 180 jour(s)			Depuis dernière RAZ 2602 jour(s)	
Atriale	26 janv. 2019 à 25 juil. 2019		25 juil. 2019 à 09 sept. 2026	
Fréquence (min ⁻¹)	Stimulé	Déecté	Stimulé	Déecté
0-29	0	10	0	237
30-39	1	187	97	14,7K
40-49	2,1K	2,7K	6,6K	19,5K
50-59	1,9M	4,1M	1,5M	19,3M
60-69	6	5,9M	9,3K	103,1M
70-79	0	3,1M	73,0K	90,4M
80-89	0	961,7K	56,7K	27,1M
90-99	24	204,8K	16,4K	3,9M
100-109	0	27,4K	2,7K	632,7K
110-119	0	9,7K	538	269,7K
120-129	0	868	1	231,1K
130-139	0	197	0	245,4K
140-149	0	174	0	302,1K
150-159	0	142	0	378,0K
160-169	0	120	0	524,7K
170-179	0	71	0	643,1K
180-189	0	52	0	673,1K
190-199	0	23	0	636,5K
200-209	0	15	0	712,7K
210-219	0	3	1	725,6K
220-229	0	4	0	949,9K
230-239	0	1	0	1,0M
240-249	0	1	0	1,3M
>=250	0	2	0	48,6M

Avant-dernière RAZ 180 jour(s)			Depuis dernière RAZ 2602 jour(s)	
Ventriculaire droit	26 janv. 2019 à 25 juil. 2019		25 juil. 2019 à 09 sept. 2026	
Fréquence (min ⁻¹)	Stimulé	Déecté	Stimulé	Déecté
0-29	0	0	0	0
30-39	0	0	0	0
40-49	791	53	2,6K	141
50-59	6,0M	6,4K	24,4M	111,5K
60-69	5,9M	5,3K	99,2M	180,1K
70-79	3,1M	5,8K	87,0M	1,7M
80-89	945,7K	15,4K	28,2M	3,7M
90-99	201,1K	29,4K	4,8M	4,8M
100-109	27,5K	8,7K	775,6K	4,2M
110-119	10,0K	4,1K	213,0K	1,9M
120-129	946	1,7K	85,0K	1,1M
130-139	239	515	30,1K	657,6K
140-149	185	375	15,7K	386,6K
150-159	194	295	7,3K	156,0K
160-169	0	197	0	45,9K
170-179	0	95	0	16,6K
180-189	0	47	0	7,7K
190-199	0	18	0	3,8K
200-209	0	10	0	1,6K
210-219	0	5	0	675
220-229	0	5	0	234
230-239	0	1	9	77
240-249	0	2	9	51
>=250	0	0	0	54


Ventriculaire gauche	Avant-dernière RAZ 180 jour(s)		Depuis dernière RAZ 2602 jour(s)	
	26 janv. 2019 à 25 juil. 2019		25 juil. 2019 à 09 sept. 2026	
	Fréquence (min ⁻¹)	Stimulé	Déecté	Stimulé
0-29	5	4	156	8,1K
30-39	5	1	1,7K	760
40-49	15,0K	3,1K	1,2M	66,2K
50-59	5,9M	4,8K	23,5M	61,9K
60-69	5,9M	5,3K	98,9M	150,7K
70-79	3,1M	5,1K	87,1M	1,1M
80-89	945,5K	13,3K	29,8M	2,3M
90-99	200,9K	30,6K	7,0M	2,3M
100-109	27,4K	14,9K	2,5M	2,5M
110-119	9,9K	1,5K	1,3M	1,2M
120-129	1,0K	527	831,2K	835,8K
130-139	299	410	167,9K	474,7K
140-149	189	362	64,6K	173,4K
150-159	193	256	12,6K	81,4K
160-169	20	203	2,0K	35,3K
170-179	5	76	326	14,8K
180-189	0	41	0	7,5K
190-199	0	15	1	3,3K
200-209	0	10	1	1,3K
210-219	0	0	2	388
220-229	0	3	1	232
230-239	0	1	8	151
240-249	0	0	8	0
>=250	1	0	10	0

Fréquence VD durant la TA/FA	Avant-dernière RAZ 180 jour(s)		Depuis dernière RAZ 2602 jour(s)	
	26 janv. 2019 à 25 juil. 2019		25 juil. 2019 à 09 sept. 2026	
	Fréquence (min ⁻¹)	Stimulé	Déecté	Stimulé
0-29	0	0	0	0
30-39	0	0	0	0
40-49	0	0	0	0
50-59	0	0	2	11
60-69	0	0	2	61
70-79	3	0	1,4M	341,6K
80-89	0	0	2,6M	1,8M
90-99	0	0	1,0M	2,4M
100-109	0	0	216,2K	2,0M
110-119	0	0	31,9K	1,3M
120-129	0	0	4,4K	930,0K
130-139	0	0	231	601,5K
140-149	0	0	1	350,7K
150-159	0	0	0	131,7K
160-169	0	0	0	30,8K
170-179	0	0	0	4,8K
180-189	0	0	0	1,1K
190-199	0	0	0	675
200-209	0	0	0	301
210-219	0	0	0	130
220-229	0	0	0	57
230-239	0	0	0	13
240-249	0	0	0	6
>=250	0	0	0	0

Variabilité de fréquence cardiaque


Dernière mesure sur une période de 24 h terminée 26 août 2026 17:37

% de temps utilisé	73
Empreinte	43 %
SDANN	75 ms
Mode	DDD
Délai AV détecté	75 - 120 ms
Cavité de stim. ventri.	BiV
Correction VG	0 ms

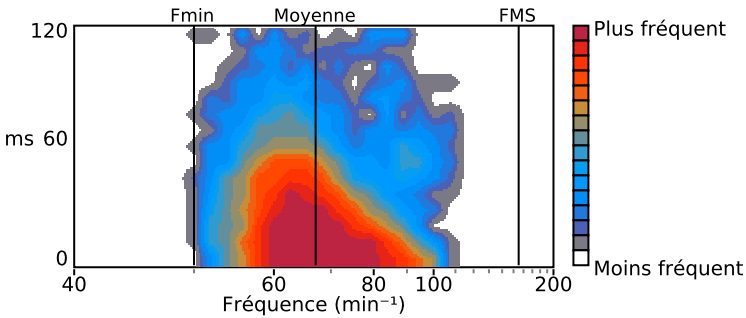


Référence : période de 24 h terminée 27 janv. 2019 15:59


% de temps utilisé	94
Empreinte	38 %
SDANN	91 ms
Mode	DDD
Délai AV détecté	75 - 120 ms
Cavité de stim. ventri.	BiV
Correction VG	0 ms

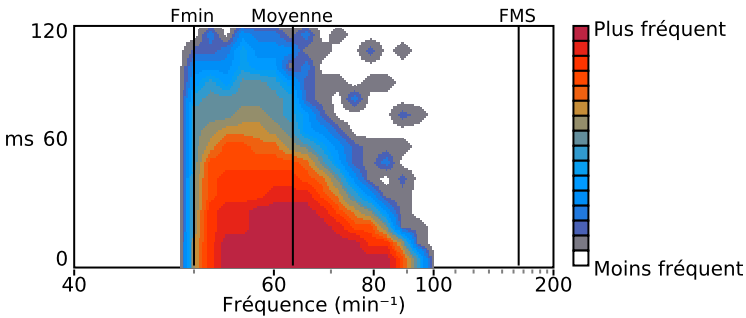


EGM temps réel (09 sept. 2026)

EGM affiché à 25 mm par seconde

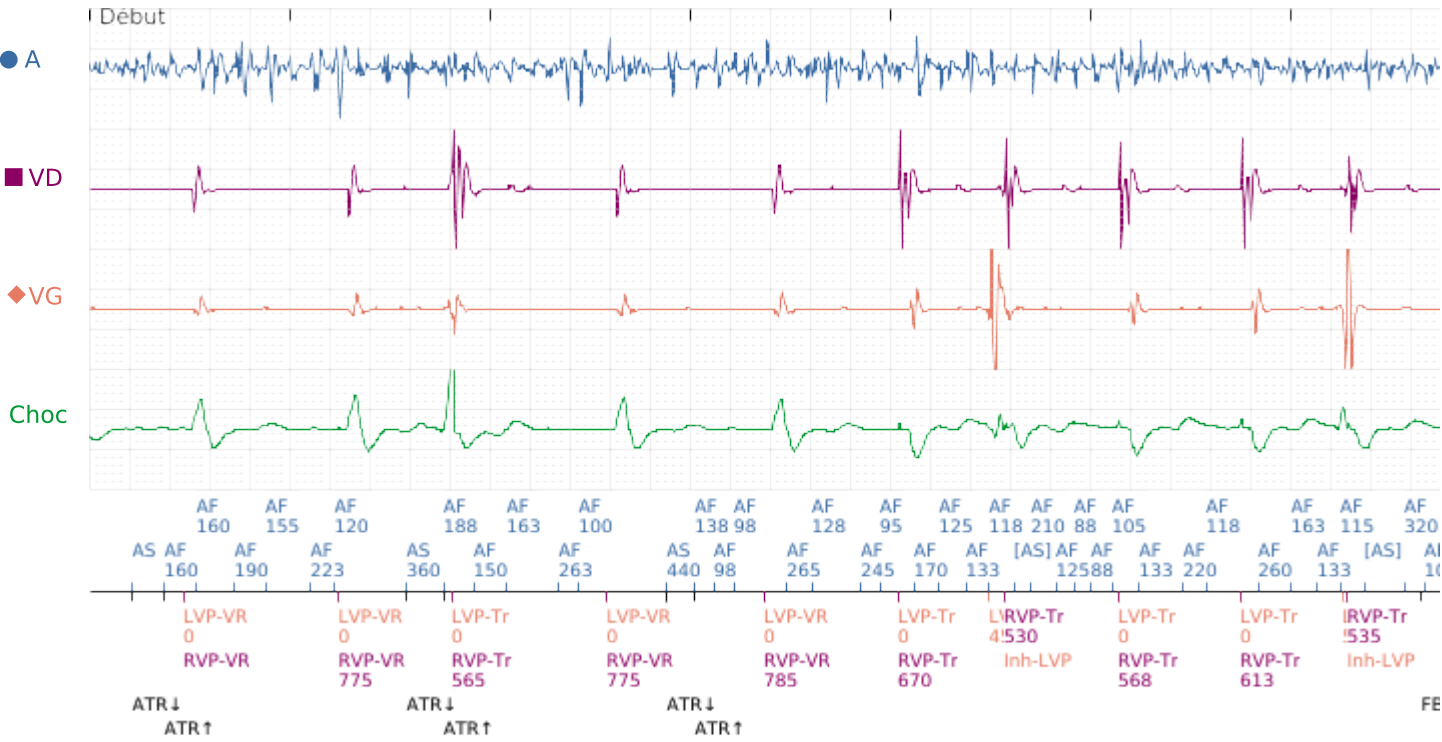

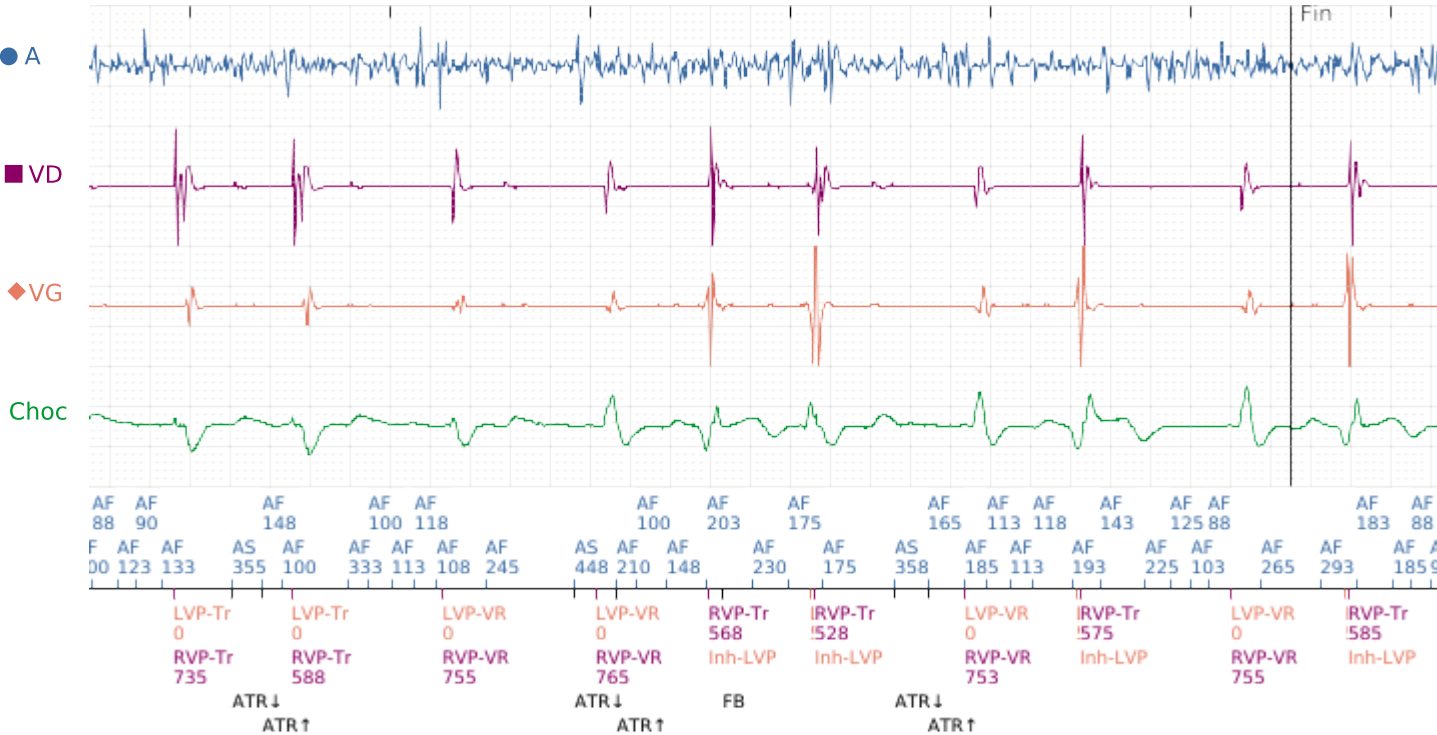



Tous les évènements depuis la dernière remise à zéro (25 juil. 2019)

08 sept. 2026 22:51	VG auto
08 sept. 2026 17:43	RTA à 225 min ⁻¹ , Fréq. V moy. en RTA : 0 min ⁻¹
08 sept. 2026 17:43	TVNS à 194 min ⁻¹ , Non soutenus
08 sept. 2026 01:49	VD auto
06 sept. 2026 07:49	VD auto
06 sept. 2026 07:47	VG auto
04 sept. 2026 13:48	VG auto
04 sept. 2026 13:47	VD auto
03 sept. 2026 16:51	VG auto
03 sept. 2026 16:50	VD auto
03 sept. 2026 01:05	RTA à 392 min ⁻¹ , Fréq. V moy. en RTA : 93 min ⁻¹
03 sept. 2026 01:04	TVNS à 195 min ⁻¹ , Non soutenus
02 sept. 2026 19:48	VG auto
02 sept. 2026 19:48	VD auto
02 sept. 2026 16:32	RTA à 258 min ⁻¹ , Fréq. V moy. en RTA : 94 min ⁻¹
02 sept. 2026 16:32	TVNS à 172 min ⁻¹ , Non soutenus
02 sept. 2026 01:21	RTA à 387 min ⁻¹ , Fréq. V moy. en RTA : 92 min ⁻¹
02 sept. 2026 01:21	TVNS à 192 min ⁻¹ , Non soutenus
26 août 2026 21:37	RTA à 269 min ⁻¹ , Fréq. V moy. en RTA : 92 min ⁻¹
26 août 2026 19:50	OD auto
22 août 2026 13:33	TVNS à 178 min ⁻¹ , Non soutenus
22 août 2026 10:52	OD auto
20 août 2026 17:33	TVNS à 180 min ⁻¹ , Non soutenus
20 août 2026 16:51	OD auto
18 août 2026 22:51	OD auto
18 août 2026 04:32	TVNS à 188 min ⁻¹ , Non soutenus
17 août 2026 04:54	OD auto
17 août 2026 03:01	TVNS à 188 min ⁻¹ , Non soutenus
11 août 2026 10:23	TVNS à 173 min ⁻¹ , Non soutenus
11 août 2026 06:30	TVNS à 189 min ⁻¹ , Non soutenus
14 mai 2026 21:50	RTA à 64 min ⁻¹ , Fréq. V moy. en RTA : 68 min ⁻¹
14 mai 2026 02:03	RTA à 64 min ⁻¹ , Fréq. V moy. en RTA : 78 min ⁻¹
13 mai 2026 09:16	RTA à 387 min ⁻¹ , Fréq. V moy. en RTA : 92 min ⁻¹
11 mai 2026 06:16	RTA à 270 min ⁻¹ , Fréq. V moy. en RTA : 86 min ⁻¹
03 mai 2026 10:36	RTA à 476 min ⁻¹ , Fréq. V moy. en RTA : 88 min ⁻¹
29 oct. 2022 23:38	TV à 203 min ⁻¹ , Pas de traitement
19 sept. 2020 14:53	 TV à 199 min ⁻¹ , ATPx1
20 avr. 2020 16:42	 TV à 186 min ⁻¹ , ATPx1
Total événem.: 2 TV, 302 TVNS, 1 Autre non traité, 69 RTA	

Batterie (suite)

Dernier choc délivré	N.R.	Temps écoulé depuis implantation	93 mois
Énergie	N.R.	Capacité restante	0.60 ampères-heures
Durée de charge	N.R.	Puissance consommée	
Impédance de choc	N.R.		83 µW
Bip quand Explantation est indiquée	Marche	(Mesurée avec les paramètres programmés) Cet appareil utilise 166 % de la puissance qu'il utiliserait avec les paramètres suivants :	
	 A	15% stimulation, 70 min ⁻¹ , 2,5 V, 0,4 ms, 500 Ω	
	 VD	100% stimulation, 70 min ⁻¹ , 2,5 V, 0,4 ms, 700 Ω	
	 aVG	100% stimulation, 70 min ⁻¹ , 3,5 V, 0,4 ms, 700 Ω	
	 bVG		Arrêt