

Rapport des épisodes sélectionnés

Date naiss.

Appareil

Mode Tachy

INCEPTA ICD F160/101100

Surveill. + Trait.

Dernière interrogation bureau

3 Mai 2012

Date implant.

26 Mar 2012

Événement V-1: 27 Mar 2012 10:08

L'événement était Induit

FV Début événem.

Fréq. V moy. : 303 min⁻¹

Déttection : Fréq. Uniq.

Référence : N.R.

Lors de la Déteçt-V

Fréq. V moy. : 420 min⁻¹

Zone de fréq. : FV

ID Rythme corrélée : Faux

RhythmMatch™: N.R.

DFS att. : (Faux, Arrêt)

Durée limite ATP : Faux

Essai 1. 21 J Choc V

Temps écoulé : 00:00:03

Tentative aband.

Pas de choc tenté dû à l'échec de reconfirmation

Essai 2, 21 J Choc V

Temps écoulé : 00:00:12


Infos de choc :


Durée de charge : 0,2 s

Impéd. sondes : 53Ω


Polarité sonde : Initial

Fin de l'événement 00:00:44

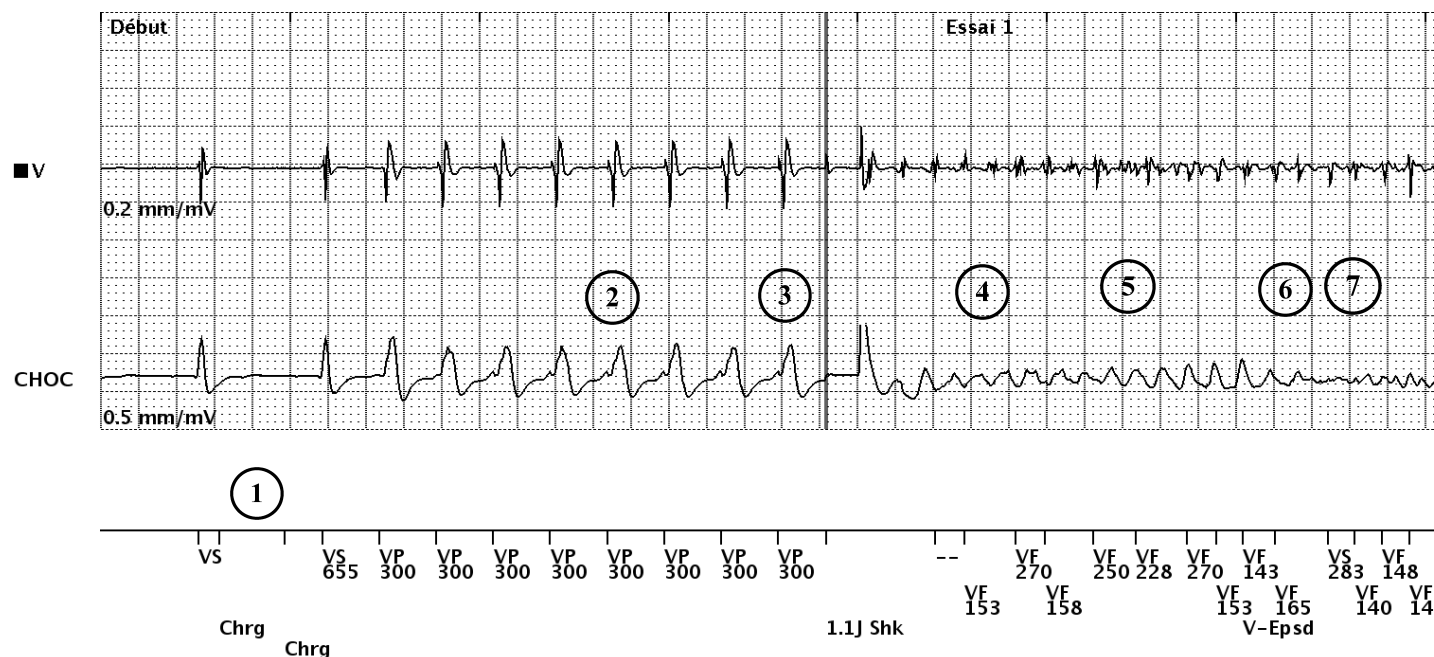


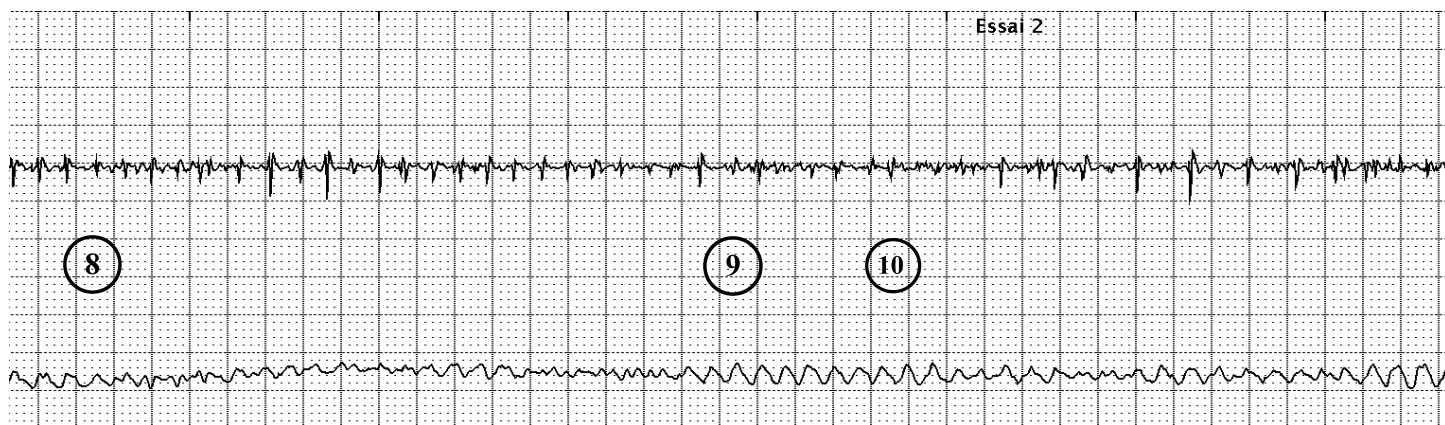

VF 145 VF 138 VS 305 VF 143 VS 325 VF 168 VF 270 VS 290 VF 143 VF 150 VF 270 VF 150 VF 255 -- VS 293 VS 305 VS 350 VF 195 VF 198 VF 235 VS 278 VS 288 VS 305 VF 258 VF 208 VF 185
3 VF 138 VF 145 VF 158 VF 138 VF 143 VF 140 VF 153 -- VS 305 VS 350 VF 148
V-Detect Chrg Dvrt

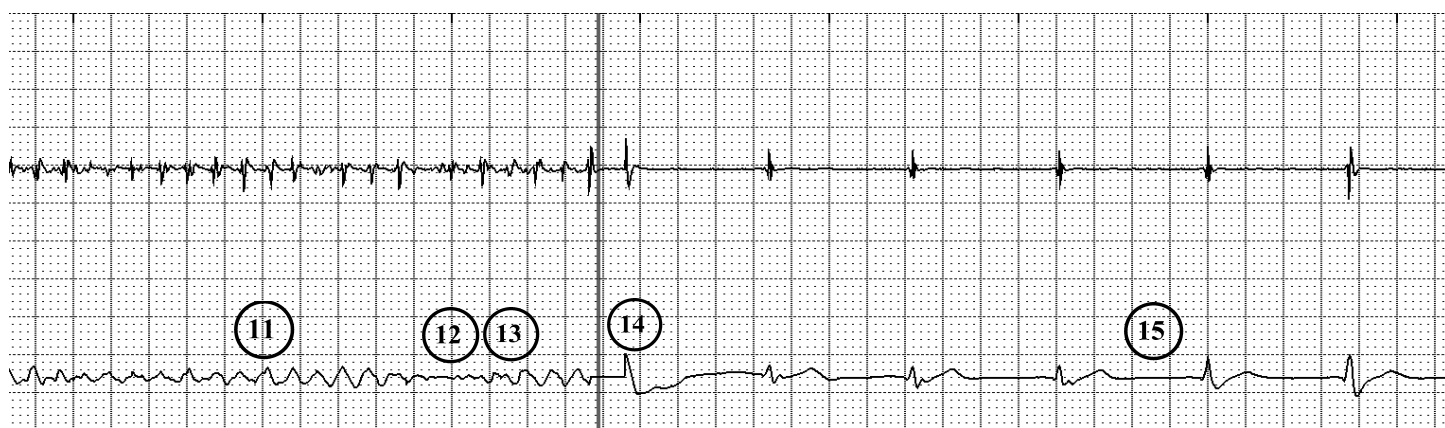

VF 138 VS 275 VS 358 VF 138 VF 160 VS 378 VF 143 VS 278 VF 180 VF 253 -- VS 753 VS 780 VS 780 VS 748
8 VF 155 VF 138 VF 145 VF 153 -- VF 140
V-Detect Chrg Chrg
21J Shk

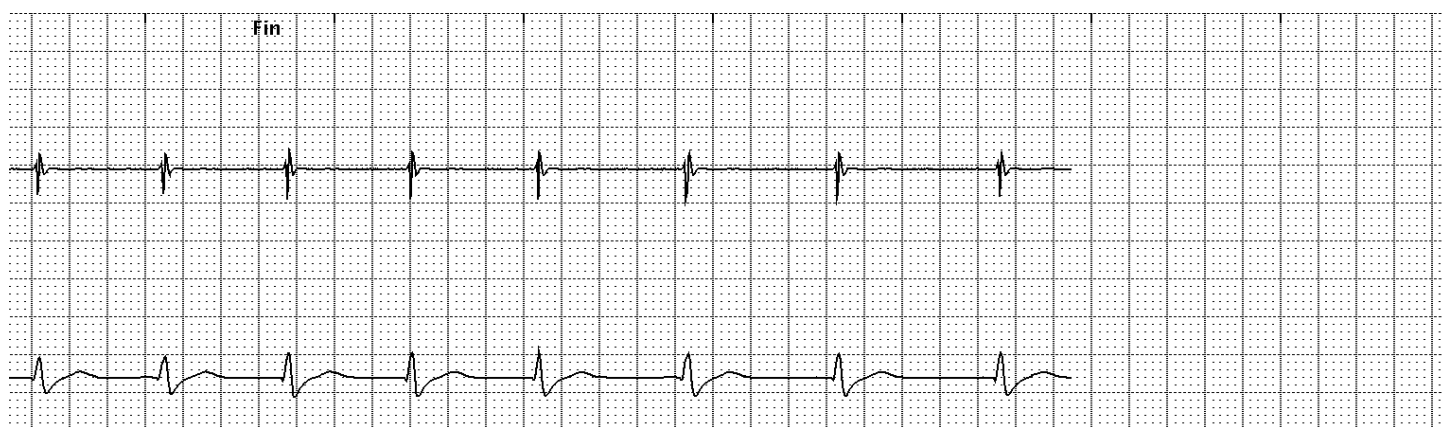

VS 690 VS 658 VS 648 VS 653 VS 675 VS 788 VS 800 VS 855



